Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

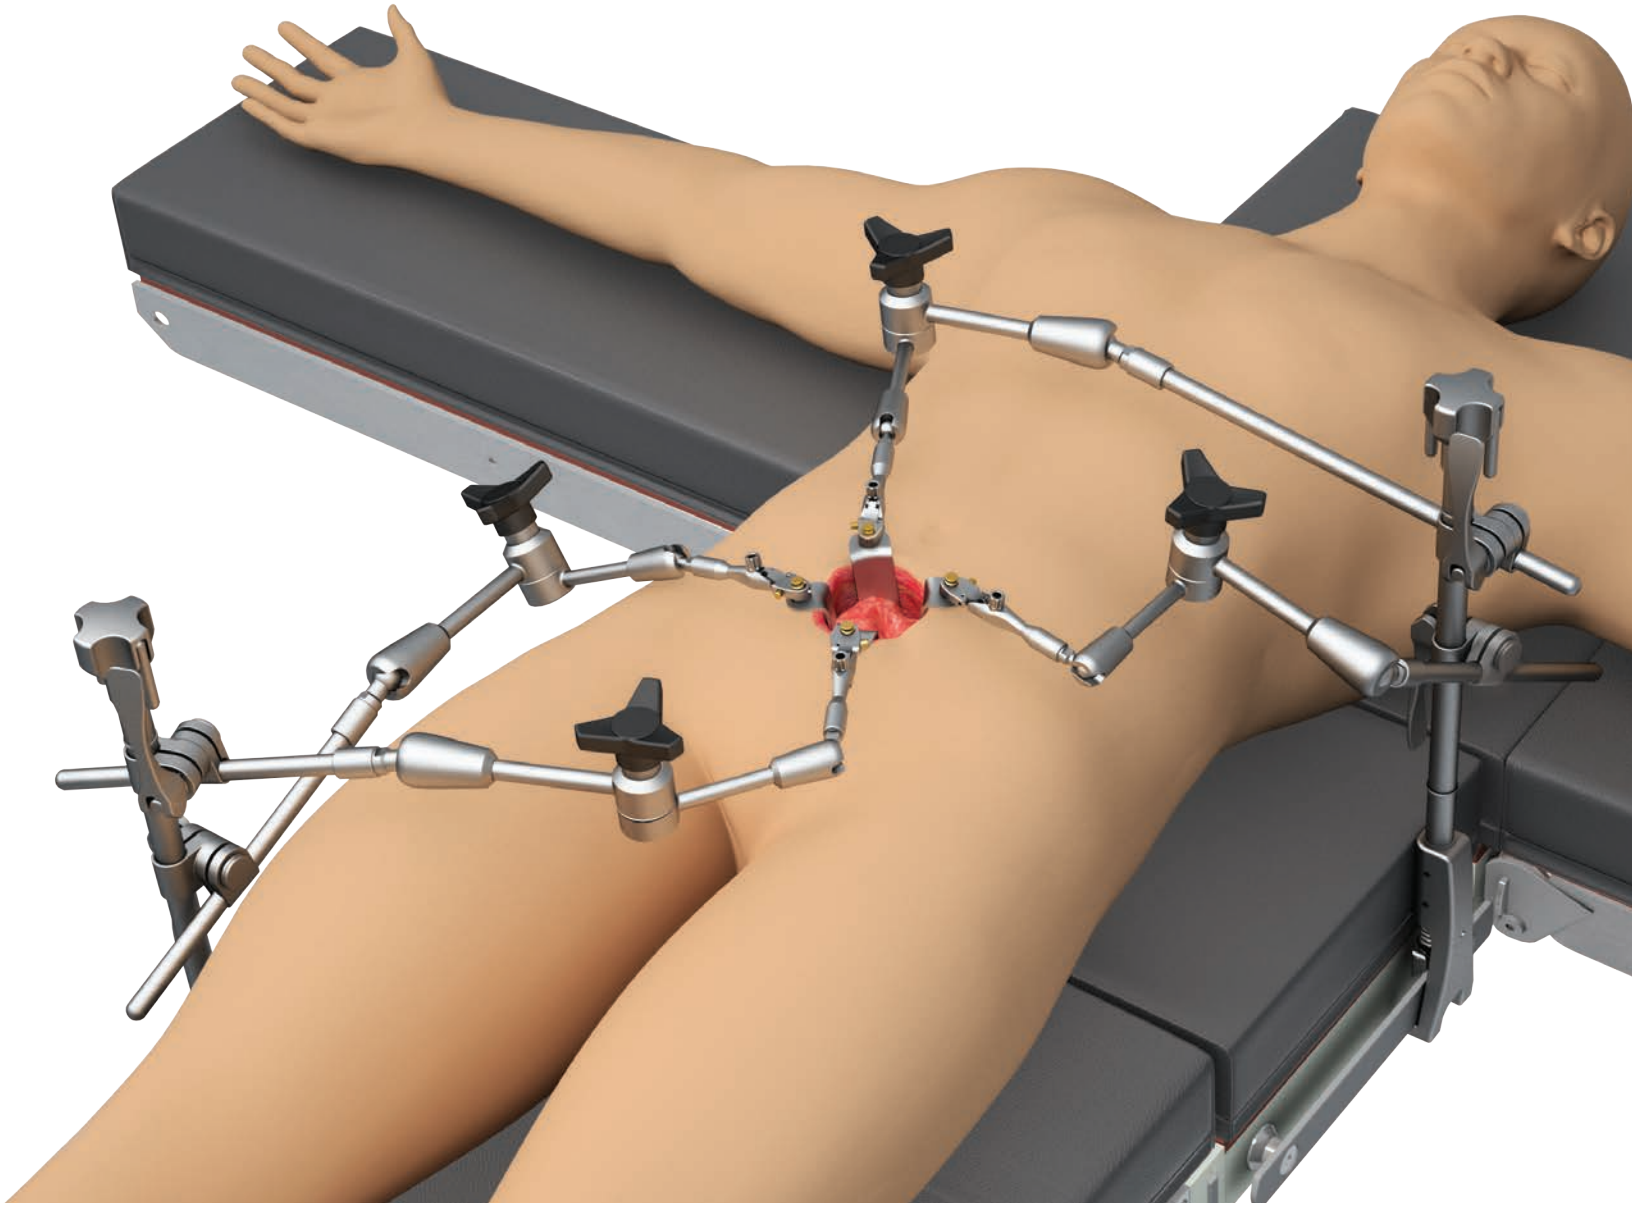

Benutzerhandbuch für das Thompson ALIF-Gelenkarmsystem:

AUFBAUANWEISUNGEN FÜR DAS THOMPSON ALIF-GELENKARMSYSTEM

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Aufbauanweisungen für den Rahmen

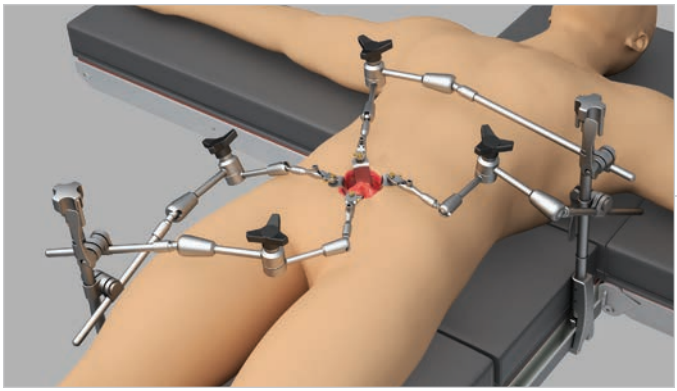

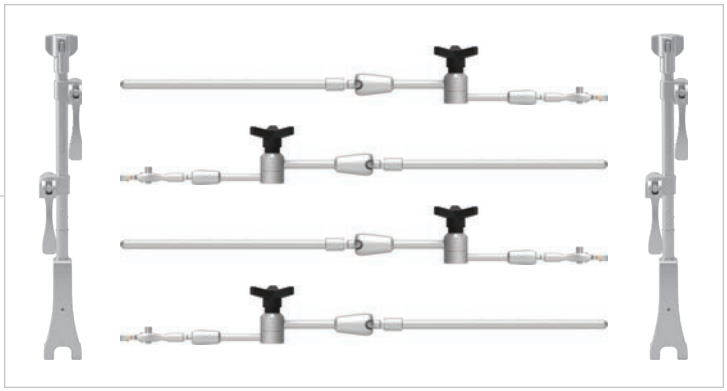

VORSICHT: Eine Kompression des Körpers des Patienten mit Rahmenkomponenten vermeiden, um Nervenschädigungen zu verhindern.

Der Thompson Retractor wird unsteril geliefert. Anweisungen zur Reinigung, Sterilisation und Pflege bitte der Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Weitere Warnungen und Vorsichtshinweise bitte der Gebrauchsanweisung zum Thompson Retractor entnehmen.

Für andere Thompson Retractor-Systeme bitte das jeweilige Benutzerhandbuch beachten.

BEI VERWENDUNG EINES JACKSON-WIRBELSÄULENTISCHES: JACKSON-RAHMENADAPTER

Den Jackson-Rahmenadapter am Tisch anbringen und durch Drehen am Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. Nach dem Befestigen kann eine Thompson Schienenklemme hinzugefügt werden.

HINWEIS: Der Jackson-Rahmenadapter ist nur zum Anbringen von Thompson Retractor bestimmt. Nicht zusammen mit anderen Retraktoren verwenden, da er eventuell nicht kompatibel ist.

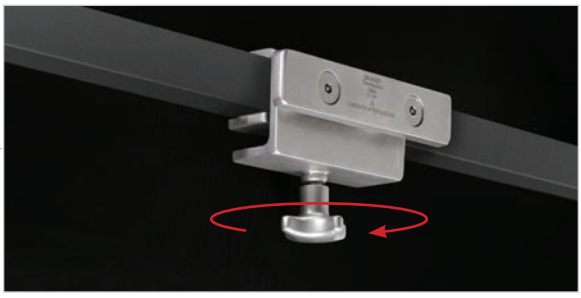

ANBRINGEN VON SCHIENENKLEMMEN

Die Elite Rail Clamp über der sterilen Abdeckung nahe der Achsel des Patienten neben der Armplatte auf die Schiene setzen und durch Drehen am oberen Knauf im Uhrzeigersinn festziehen. Den Vorgang auf der kontralateralen Tischseite nahe dem Oberschenkel 25 bis 30 cm unterhalb der Inzisionsmitte wiederholen.

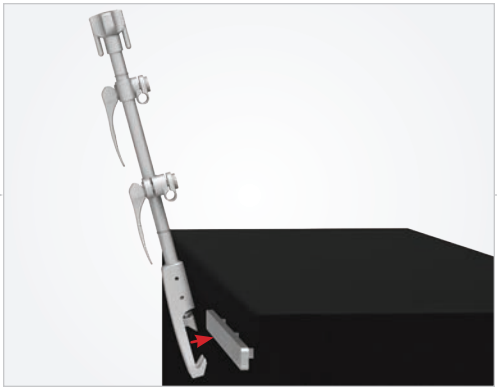

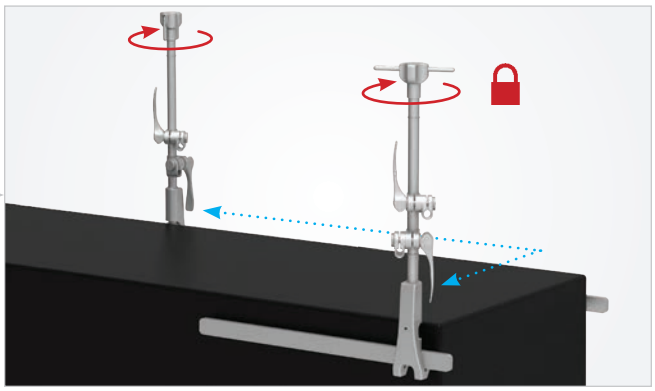

Aufbauanweisungen für den Rahmen *(Fortsetzung)*

ANBRINGEN VON GELENKARMEN

Bei entriegeltem Gelenk der Schienenklemme den Gelenkarm in das Gelenk der Schienenklemme einführen und wie erforderlich positionieren. Durch Umlegen des Nockenhebels verriegeln. Den Vorgang mit den übrigen Armen wiederholen.

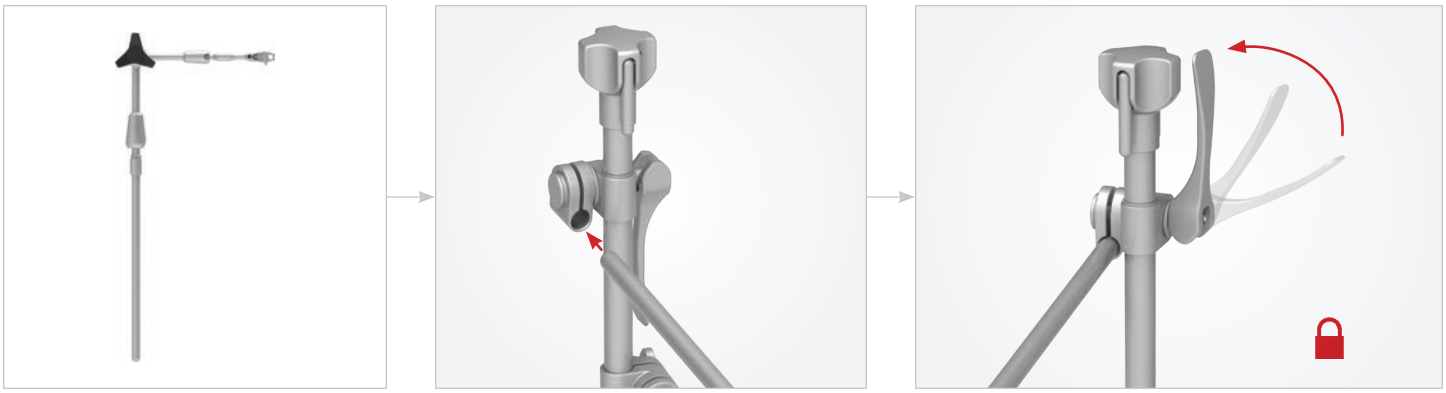

EINSTELLEN DER GELENKARME

Um einen Arm zu verstellen, den schwarzen Knauf gegen den Uhrzeigersinn losdrehen. Die erforderliche Einstellung vornehmen und den Knauf im Uhrzeigersinn drehen, um ihn festzuziehen und die Position zu sichern.

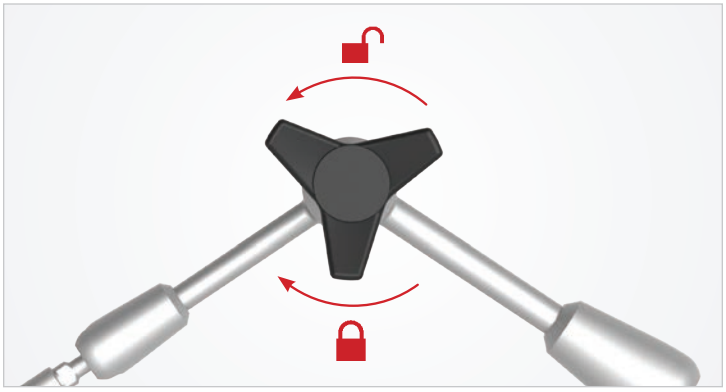

Anbringen und Einstellen von Retraktorblättern

S-LOCK®

Um das Blatt am Griff anzubringen, die Taste drücken und den Vorsprung am Blatt einstecken. Um das Blatt freizugeben und zwischen den Stellungen „Schwenken" und „Verriegelt" zu wechseln, die Taste drücken.

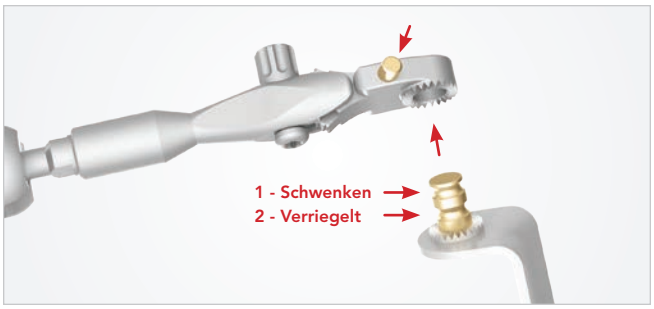

SCHNELLANWINKELUNG

Die Blätter können von Hand oder mit dem T-Griff um 45° nach oben oder unten angewinkelt werden.

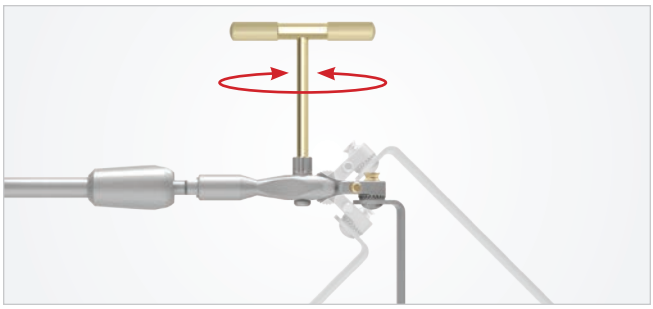

Fragen oder weitere Informationen:

+1 231 922 0177

Rev. A
041822
alaaum-de

Uncompromised Exposure

BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
Telefon: +1 231 922 0177
Fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
NIEDERLANDE

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ⊗ und das Logo „T Circle" sind eingetragene Marken von Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patente: trpat.com

Hinweis: Aufgrund unserer laufenden Produktverbesserung können manche Abbildungen in diesem Dokument geringfügige Abweichungen vom ausgelieferten Produkt aufweisen.

Made In USA