Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

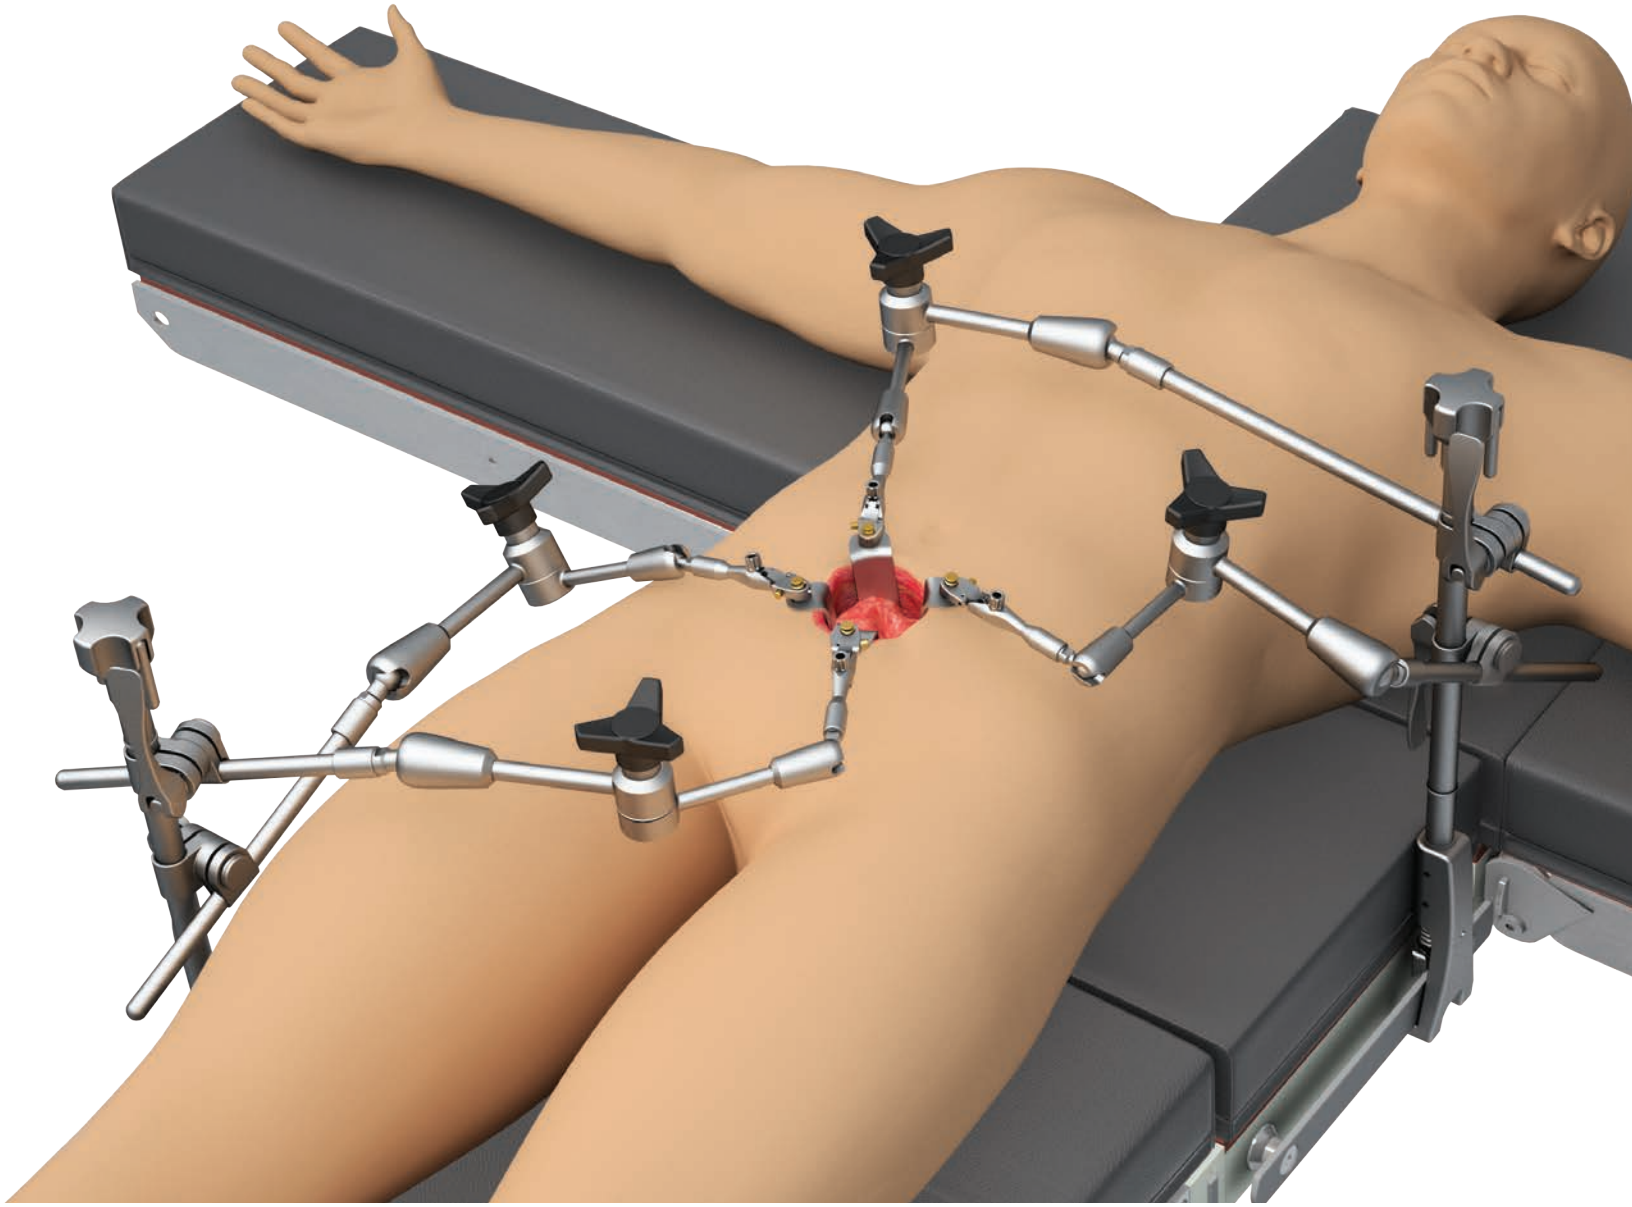

Manuale dell'utente del sistema Thompson di bracci articolati ALIF:

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA THOMPSON DI BRACCI ARTICOLATI ALIF

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Istruzioni per l'installazione del telaio

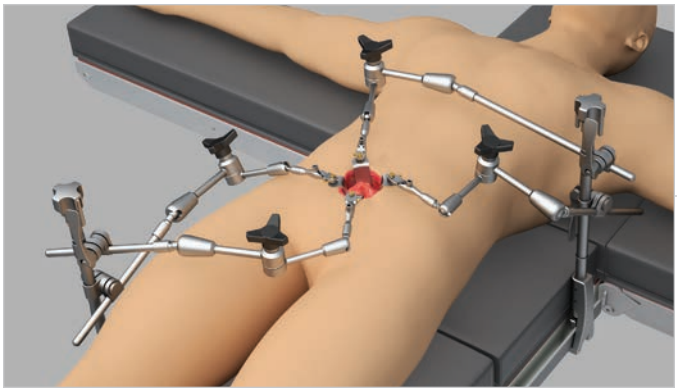

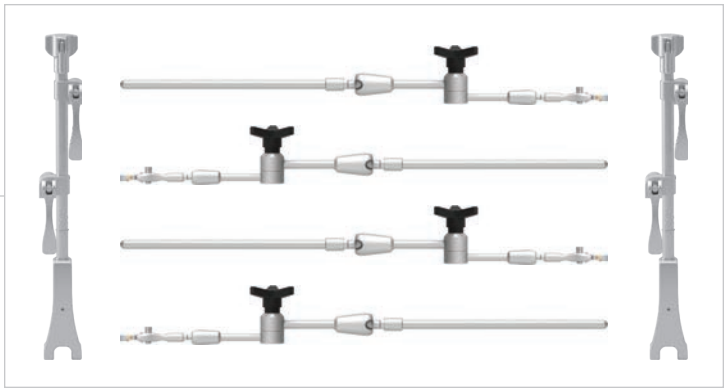

ATTENZIONE: per prevenire lesioni dei nervi, evitare di comprimere il corpo del paziente con componenti del telaio.

Thompson Retractor è fornito non sterile. Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del Thompson Retractor per le istruzioni di pulizia, sterilizzazione e cura.

Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del Thompson Retractor per ulteriori avvertenze e precauzioni.

Per altri sistemi Thompson Retractor, fare riferimento al manuale dell'utente di ognuno di essi.

UTILIZZO DI UN TAVOLO OPERATORIO PER CHIRURGIA VERTEBRALE JACKSON: ADATTATORE PER TELAIO JACKSON

Posizionare l'adattatore per telaio Jackson sul tavolo e serrare ruotando la manopola in senso orario. Una volta effettuato il serraggio, si può aggiungere una clamp per binario Thompson.

NOTA: l'adattatore per telaio Jackson può essere utilizzato esclusivamente per il fissaggio dei Thompson Retractor. NON USARE con altri divaricatori perché potrebbe non essere compatibile.

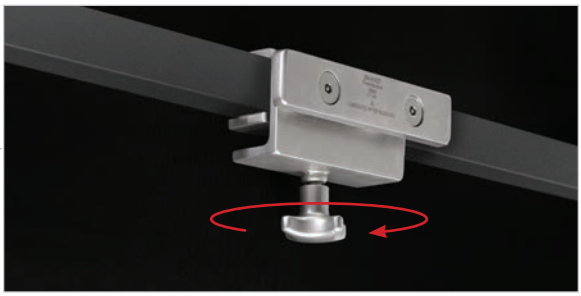

AGGIUNTA DEI CLAMP PER BINARIO

Collocare Elite Rail Clamp sul binario sopra il telo sterile vicino all'ascella del paziente, adiacente al bracciolo e serrare facendo ruotare la manopola superiore in senso orario. Ripetere sul lato opposto del tavolo, vicino alla parte superiore della coscia, a 25-30 cm al di sotto del punto medio dell'incisione.

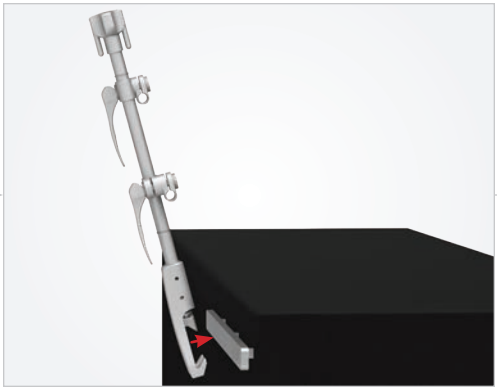

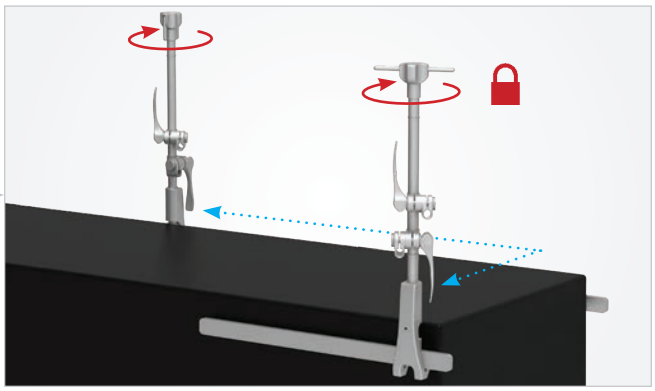

Istruzioni per l'installazione del telaio *(continua)*

AGGIUNTA DEI BRACCI ARTICOLATI

Quando il giunto del clamp per binario è nella posizione sbloccata, inserirvi il braccio articolato e posizionare in base alle esigenze. Bloccare capovolgendo l'impugnatura a camma. Ripetere con i bracci rimanenti.

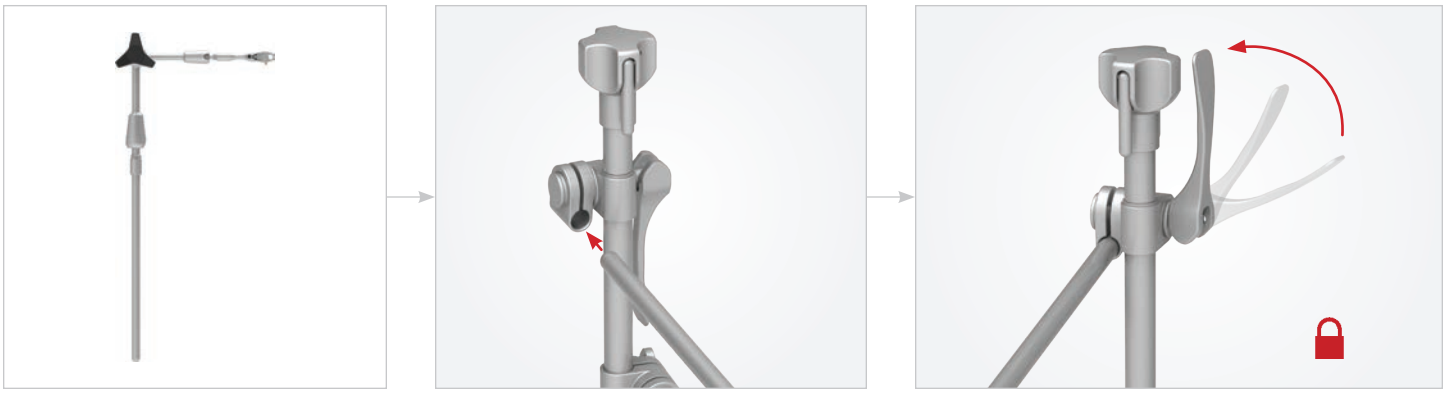

REGOLAZIONE DEI BRACCI ARTICOLATI

Per regolare il braccio, ruotare la manopola nera in senso antiorario per allentare o regolare in base alle esigenze e in senso orario per serrare e fissare il posizionamento.

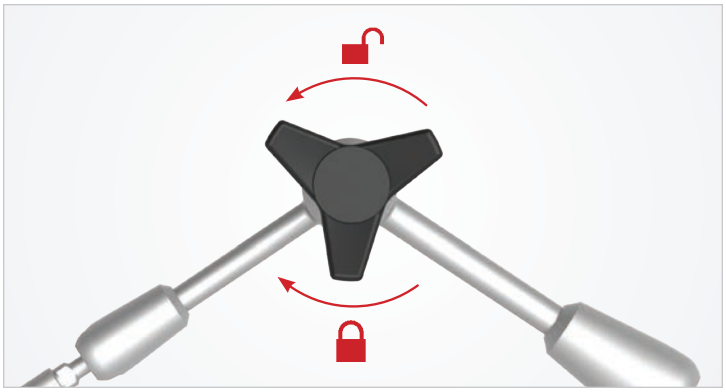

Aggiunta e regolazione delle lame di retrazione

S-LOCK®

Collegare la lama all'impugnatura spingendo lo stantuffo e inserendo il nipplo della lama. Spingere lo stantuffo per rilasciare la lama e passare dalla posizione "girevole" a quella "bloccata".

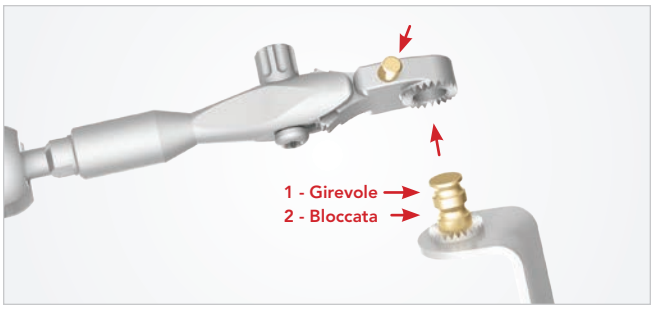

ANGOLO RAPIDO

Le lame possono essere inclinate di 45° verso l'alto o verso il basso a mano o con l'impugnatura a T.

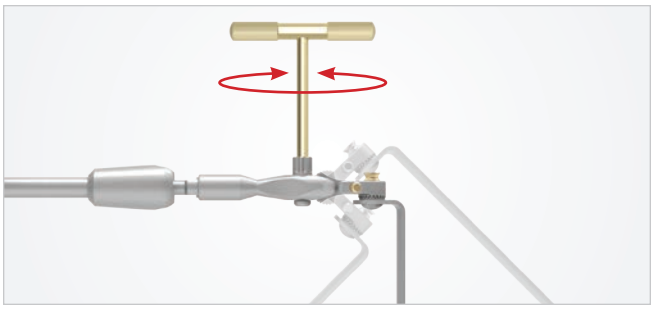

Domande o ulteriori informazioni:

+1 231 922 0177

Rev A
041822
alaaum-it

Uncompromised Exposure

VISITATECI ONLINE: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684, Stati Uniti
telefono: +1 231.922.0177
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAESI BASSI

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® e il logomarchio "T Circle" sono marchi registrati di Thompson Surgical Instruments, Inc.
Brevetti: trpat.com

Nota: ci impegniamo costantemente a fornire i migliori prodotti possibili; alcune delle immagini nel presente documento possono apparire leggermente diverse dal prodotto ricevuto.

Made In USA