Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

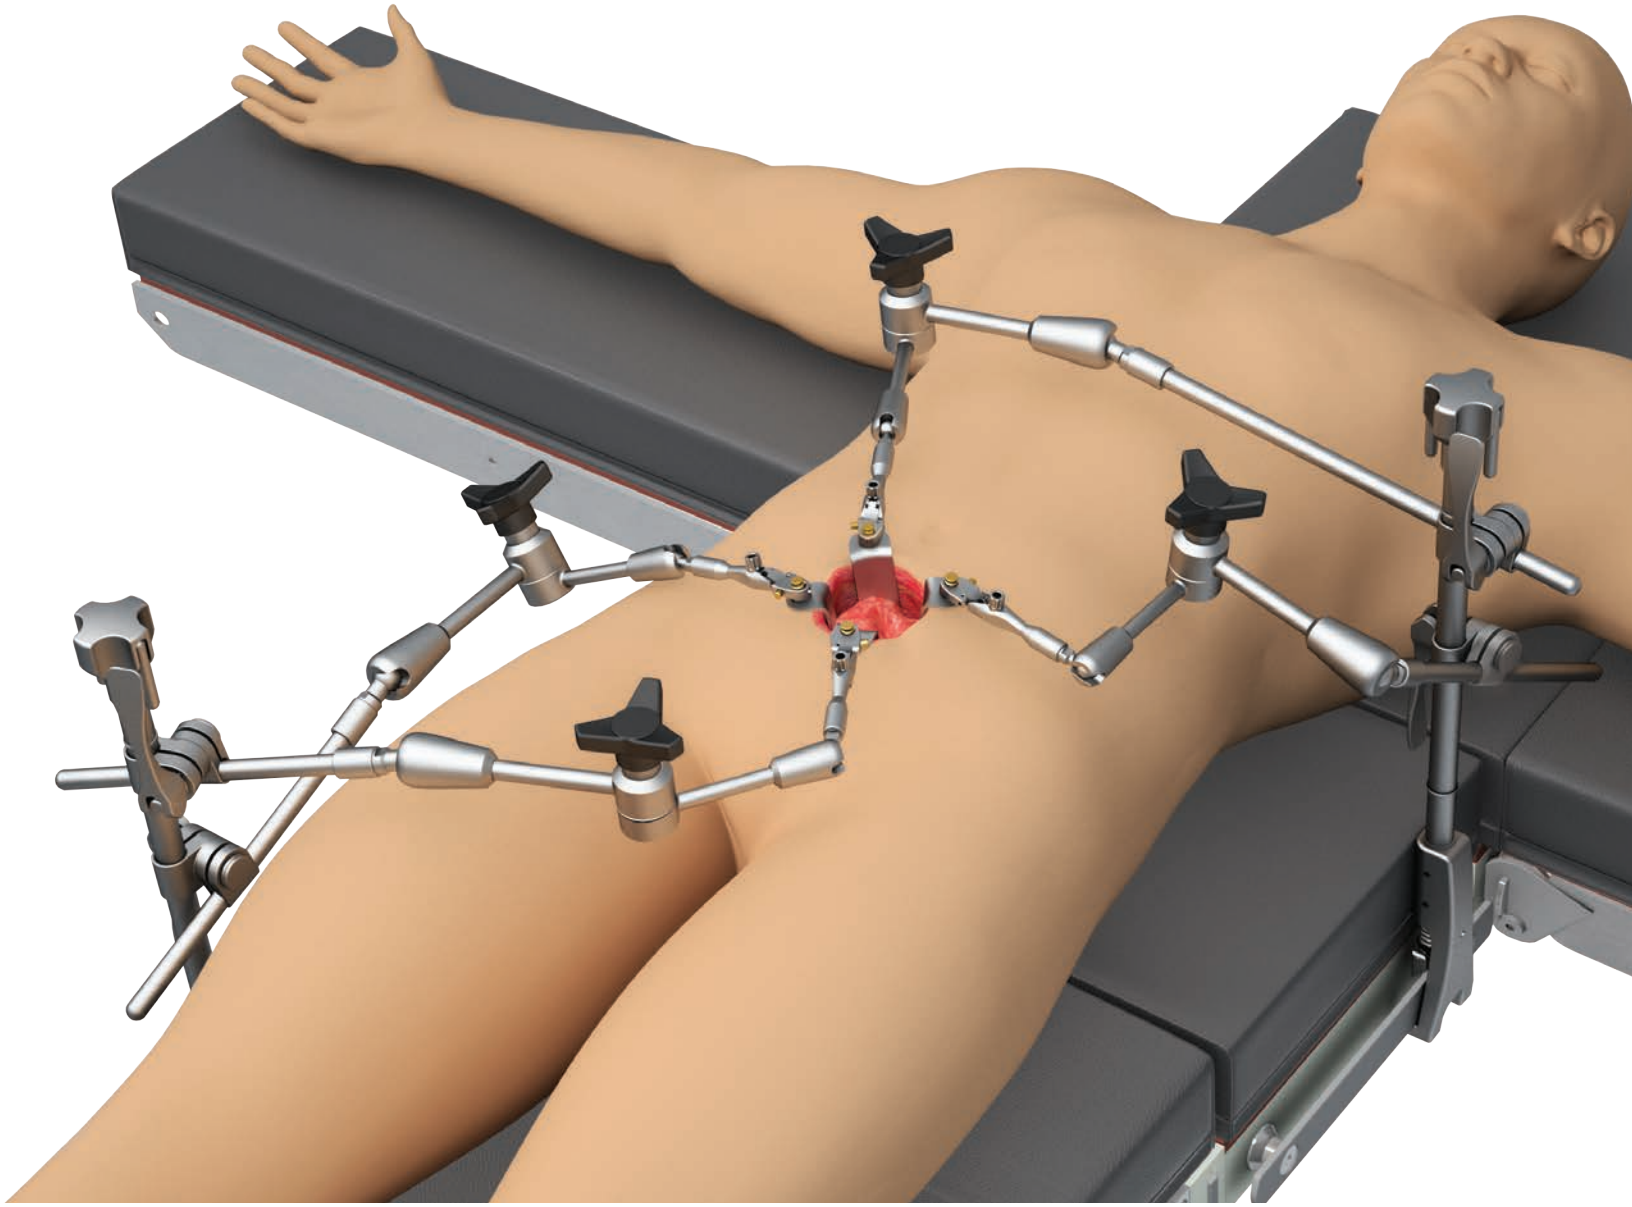

Thompson ALIF連接アームシステム ユーザーマニュアル：

THOMPSON ALIF連接アームシステムのセットアップ手順

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

フレームのセットアップ手順

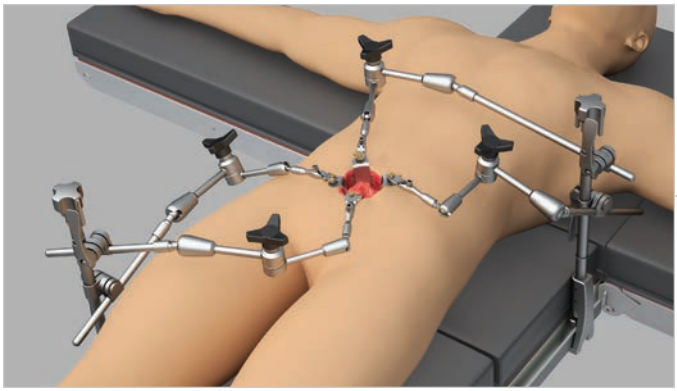

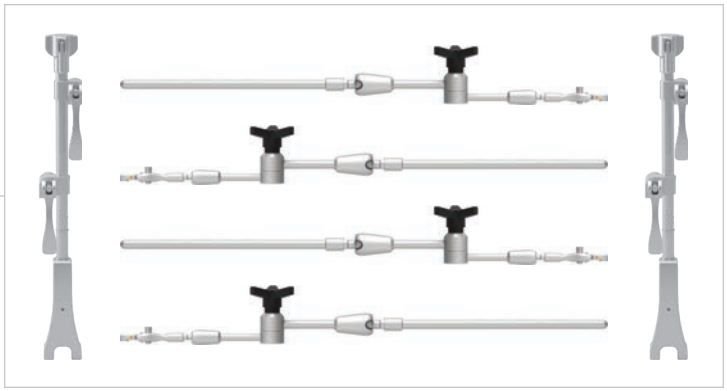

注意：神経の損傷を防ぐため、患者の身体をフレームコンポーネントで圧迫することは避けてください。

Thompson Retractorは、未滅菌の状態で提供されています。洗浄、滅菌およびお手入れの方法については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他の警告と注意については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他のThompson Retractorシステムについては対応する各ユーザーマニュアルを参照してください。

JACKSON脊椎テーブルを使用する場合：JACKSONフレームアダプター

Jacksonフレームアダプターをテーブルに置き、ノブを時計回りに回して締めます。固定したら、Thompsonレールクランプを追加できます。

注記：Jacksonフレームアダプターは、Thompson Retractorの取り付け専用です。互換性がない可能性があるため、他のリトラクターと一緒に使用しないでください。

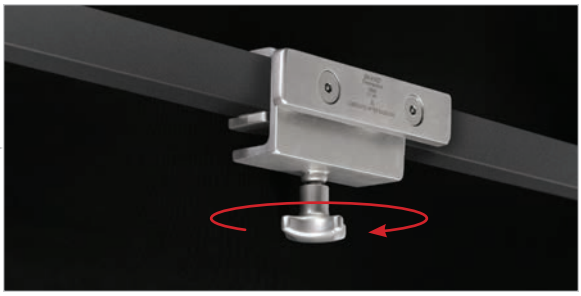

レールクランプの追加

Elite Rail Clampを、患者の腋窩近くのアームボードに隣接する滅菌ドレープ上のレールに配置し、上部ノブを時計回りに回して締めます。テーブルの反対側、大腿上部近く、切開の中点から25 cm～30 cm下で同じことを繰り返します。

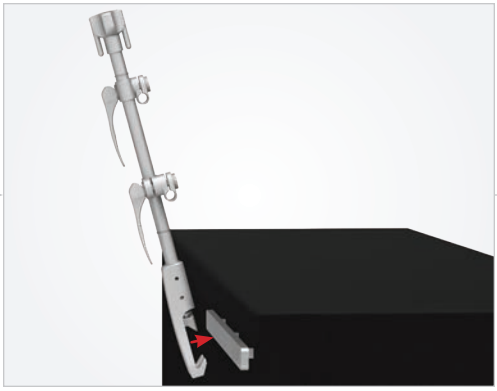

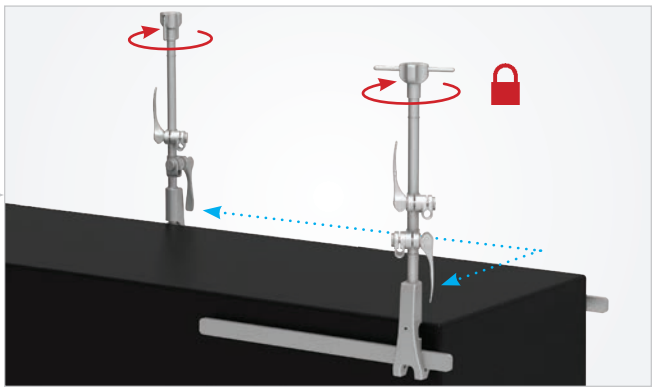

フレームのセットアップ手順 (続き)

連接アームの追加

レールクランプのジョイントのロックを解除した状態で、連接アームをレールクランプのジョイントに挿入して必要に応じて位置を決めます。カムハンドルをフリップさせて固定します。残りのアームにも同じことを繰り返します。

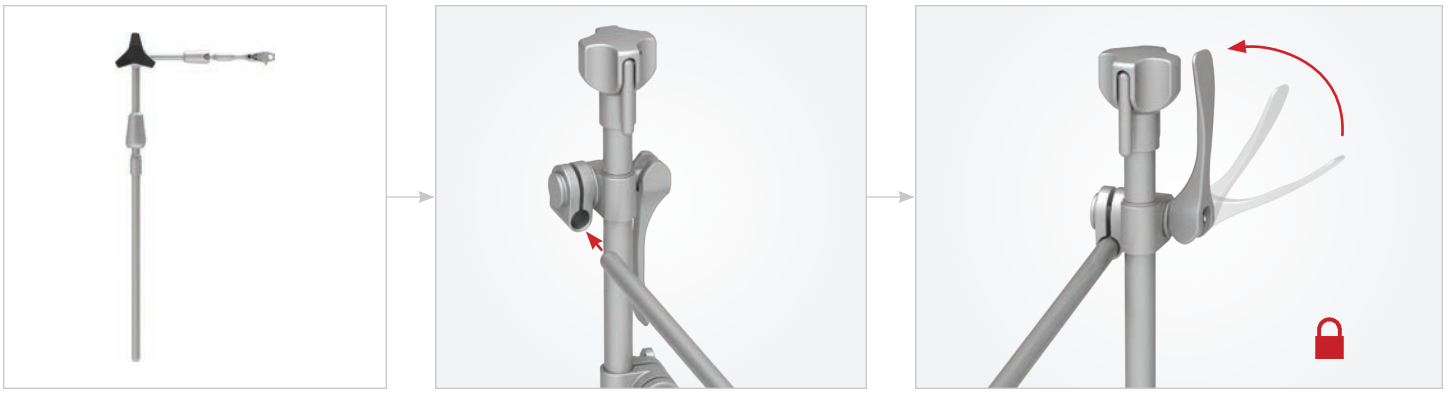

連接アームの調整

アームを調整するには、黒色ノブを反時計回りに回して緩め、必要に応じて調整し、ノブを時計回りに回して締め、位置を固定します。

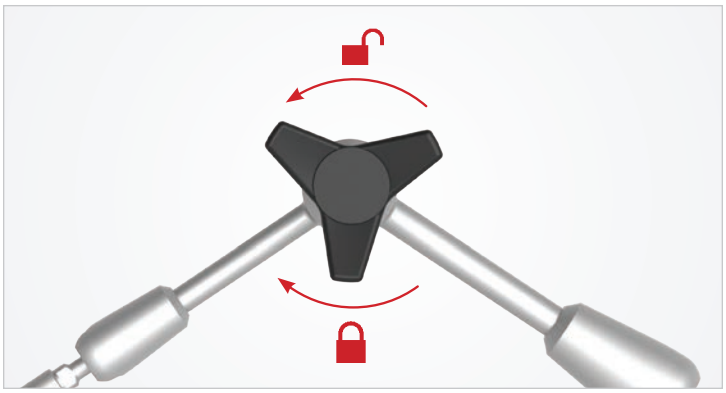

リトラクターブレードの追加と調整

S-LOCK®

プランジャーを押し、ブレードのニップルを挿入してブレードをハンドルに取り付けます。プランジャーを押してブレードを解放すると「回転」と「ロック」位置間を切り替えることができます。

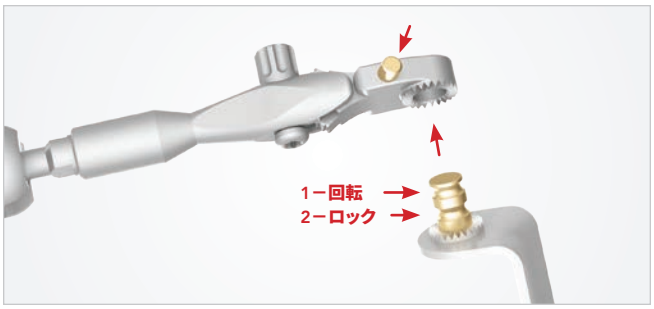

クイックアングル

ブレードは手またはT型ハンドルで上下45度に角度を調節できます。

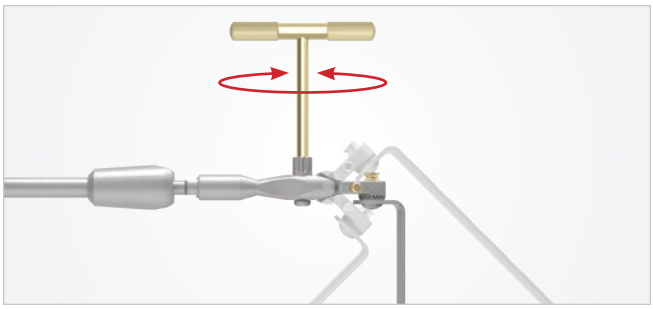

ご質問がある場合、またはさらに詳しい情報が必要な場合は以下にご連絡ください：

+1 231 922 0177

Rev A
041822
alaaum-ja

Uncompromised Exposure

当社のホームページをご覧ください：**THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
電話番号：+1 231 922 0177
ファックス：+1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
オランダ

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ®およびThompsonの T Circle ロゴマーク®はThompson Surgical Instruments, Inc.の登録商標です。
特許権利者：trpat.com
注記：最適な製品の提供に努めておりますが、この文書に記載されている画像の一部は、実際の製品と若干異なることがあります。

Made In USA