Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

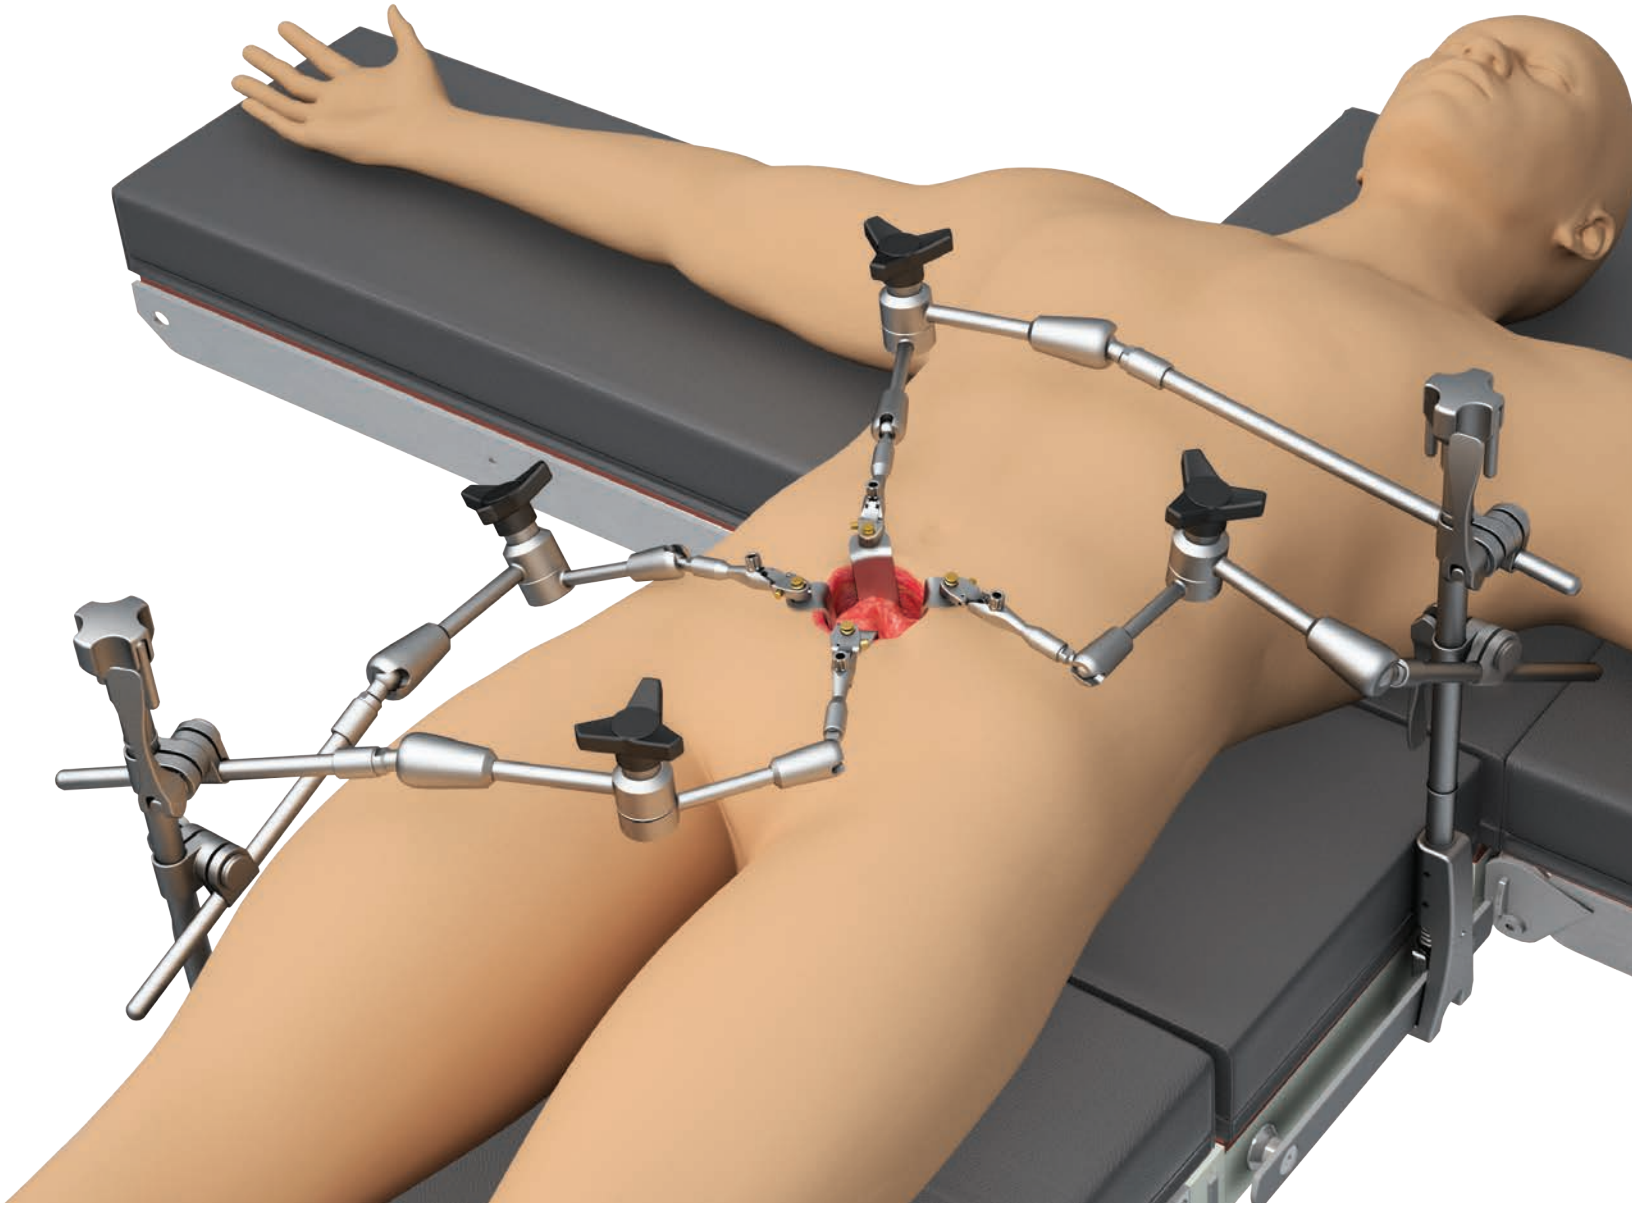

Manual de utilizador do sistema de braços articulados ALIF Thompson:

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA O SISTEMA DE BRAÇOS ARTICULADOS ALIF THOMPSON

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Instruções de instalação da estrutura

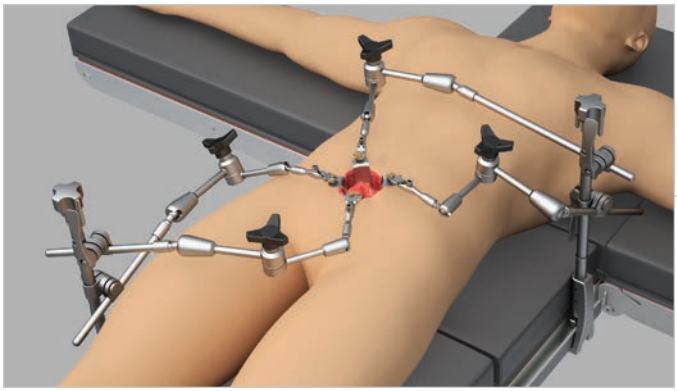

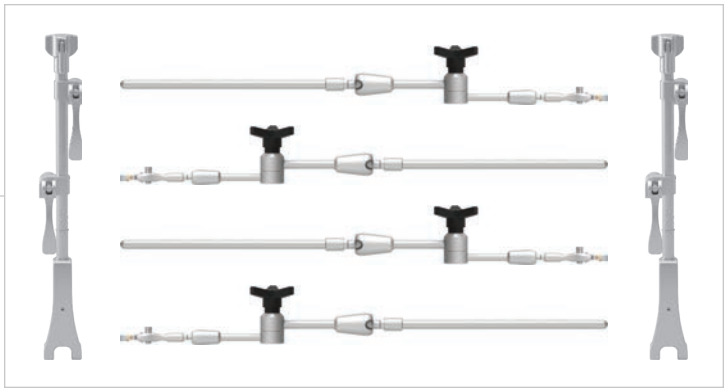

PRECAUÇÃO: Evitar comprimir o corpo do doente com componentes estruturais para prevenir danos nos nervos.

O Thompson Retractor é fornecido em estado não estéril. Consultar as IDU do Thompson Retractor para instruções de limpeza, esterilização e cuidado.

Consultar as Instruções de Utilização do Thompson Retractor para avisos e precauções adicionais.

Para outros Sistemas Thompson Retractor, consultar os respetivos Manuais de Utilizador.

SE ESTIVER A UTILIZAR UMA MESA DE COLUNA VERTEBRAL JACKSON: ADAPTADOR DA ESTRUTURA JACKSON

Coloque o adaptador da estrutura Jackson na mesa e rode no sentido horário para apertar. Depois de estar seguro, pode ser adicionado um grampo da calha Thompson.

NOTA: O adaptador da estrutura Jackson destina-se exclusivamente à fixação de Thompson Retractor. NÃO utilizar com outros retratores, uma vez que pode não ser compatível.

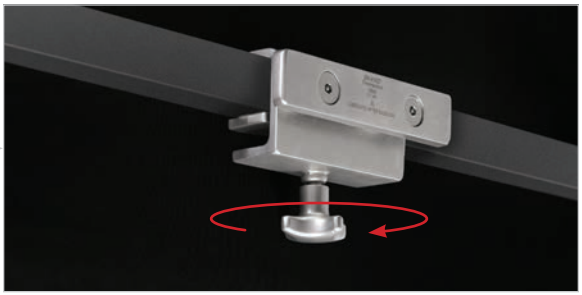

ADIÇÃO DE GRAMPOS DA CALHA

Coloque o Elite Rail Clamp na calha sobre o pano estéril junto à axila do paciente, adjacente ao painel para o braço, e rode o botão superior no sentido horário para apertar. Repita no lado oposto da mesa, junto à parte superior da coxa, 25 a 30 cm abaixo do ponto médio de incisão.

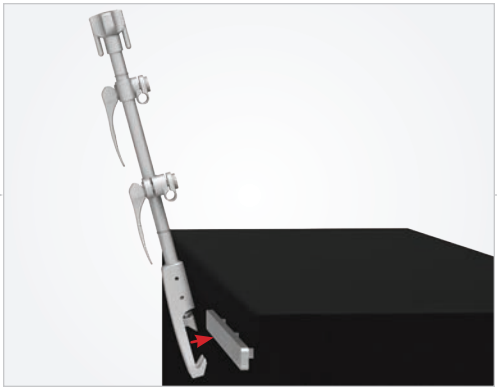

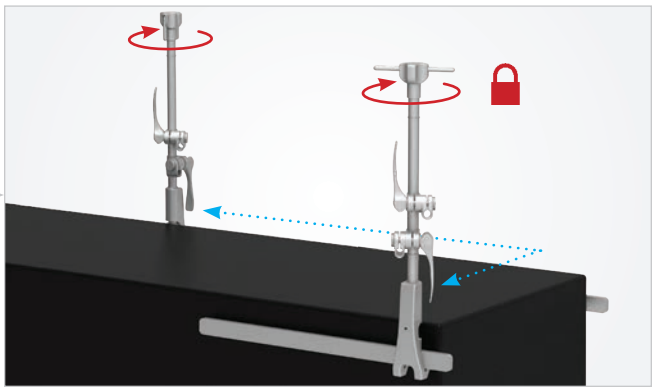

Instruções de instalação da estrutura *(continuação)*

ADIÇÃO DE BRAÇOS ARTICULADOS

Com a junta do grampo da calha na posição destravada, insira o braço articulado na junta do grampo da calha e posicione conforme necessário. Fixe virando o manípulo de came. Repita com os braços restantes.

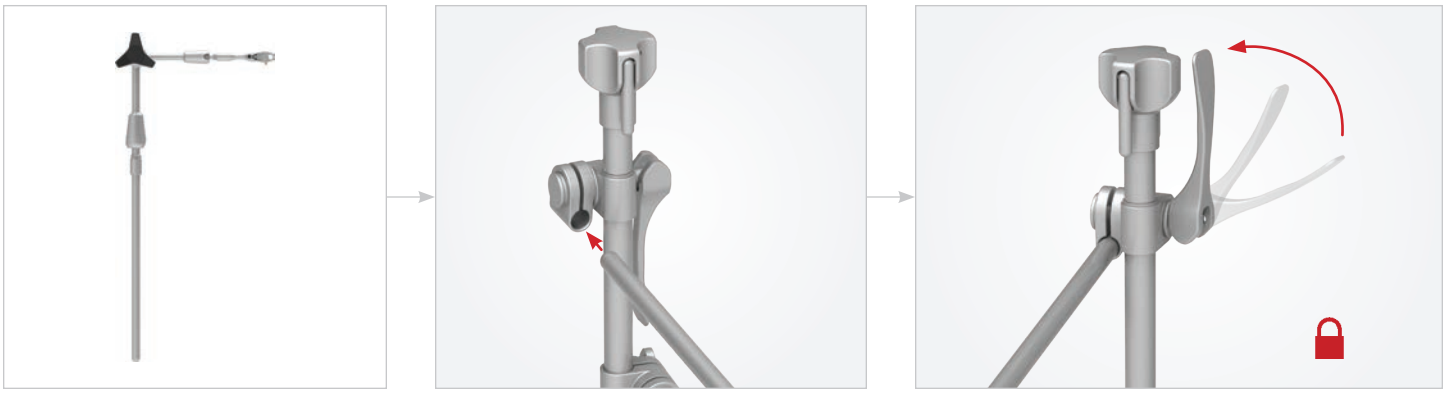

AJUSTE DOS BRAÇOS ARTICULADOS

Para ajustar o braço, rode o manípulo preto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar, ajuste conforme necessário e rode o manípulo no no sentido dos ponteiros do relógio para apertar e fixar o posicionamento.

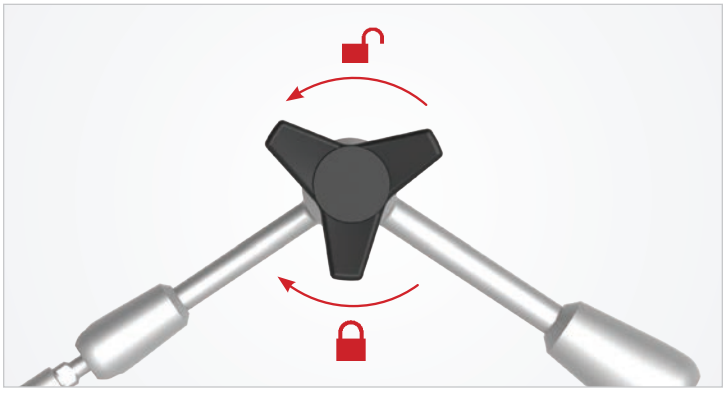

Adição e ajuste das lâminas do retrator

S-LOCK®

Fixar a lâmina ao manípulo empurrando o êmbolo e inserindo o espigão da lâmina. Empurre o êmbolo para libertar a lâmina e alternar entre as posições "girar" e "bloqueada".

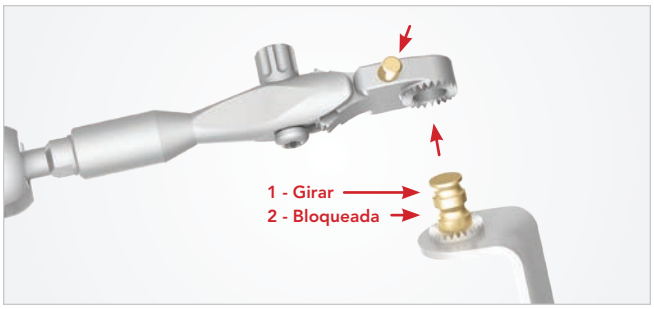

ÂNGULO RÁPIDO

As lâminas podem ser inclinadas 45° para cima ou para baixo manualmente com o manípulo em T.

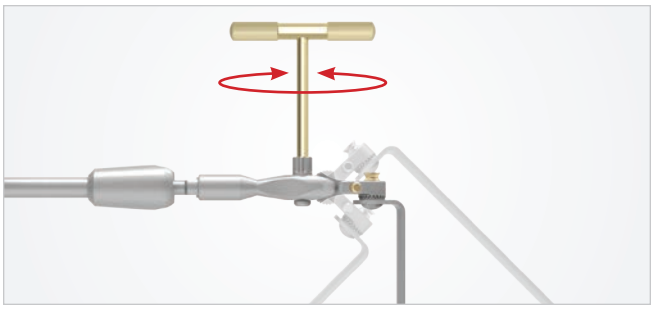

Perguntas ou Informações Adicionais:

+1 231 922 0177

Rev A
041822
alaaum-pt

Uncompromised Exposure

VISITE-NOS ONLINE: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
telefone: +1 231 922 0177
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAÍSES BAIXOS

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® e o logótipo "T Circle" são marcas comerciais registadas da Thompson Surgical Instruments, Inc.
Patentes: trpat.com

Nota: Uma vez que trabalhamos continuamente para fornecer os melhores produtos possíveis, algumas imagens neste documento podem diferir ligeiramente do produto recebido.

Made In USA