Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

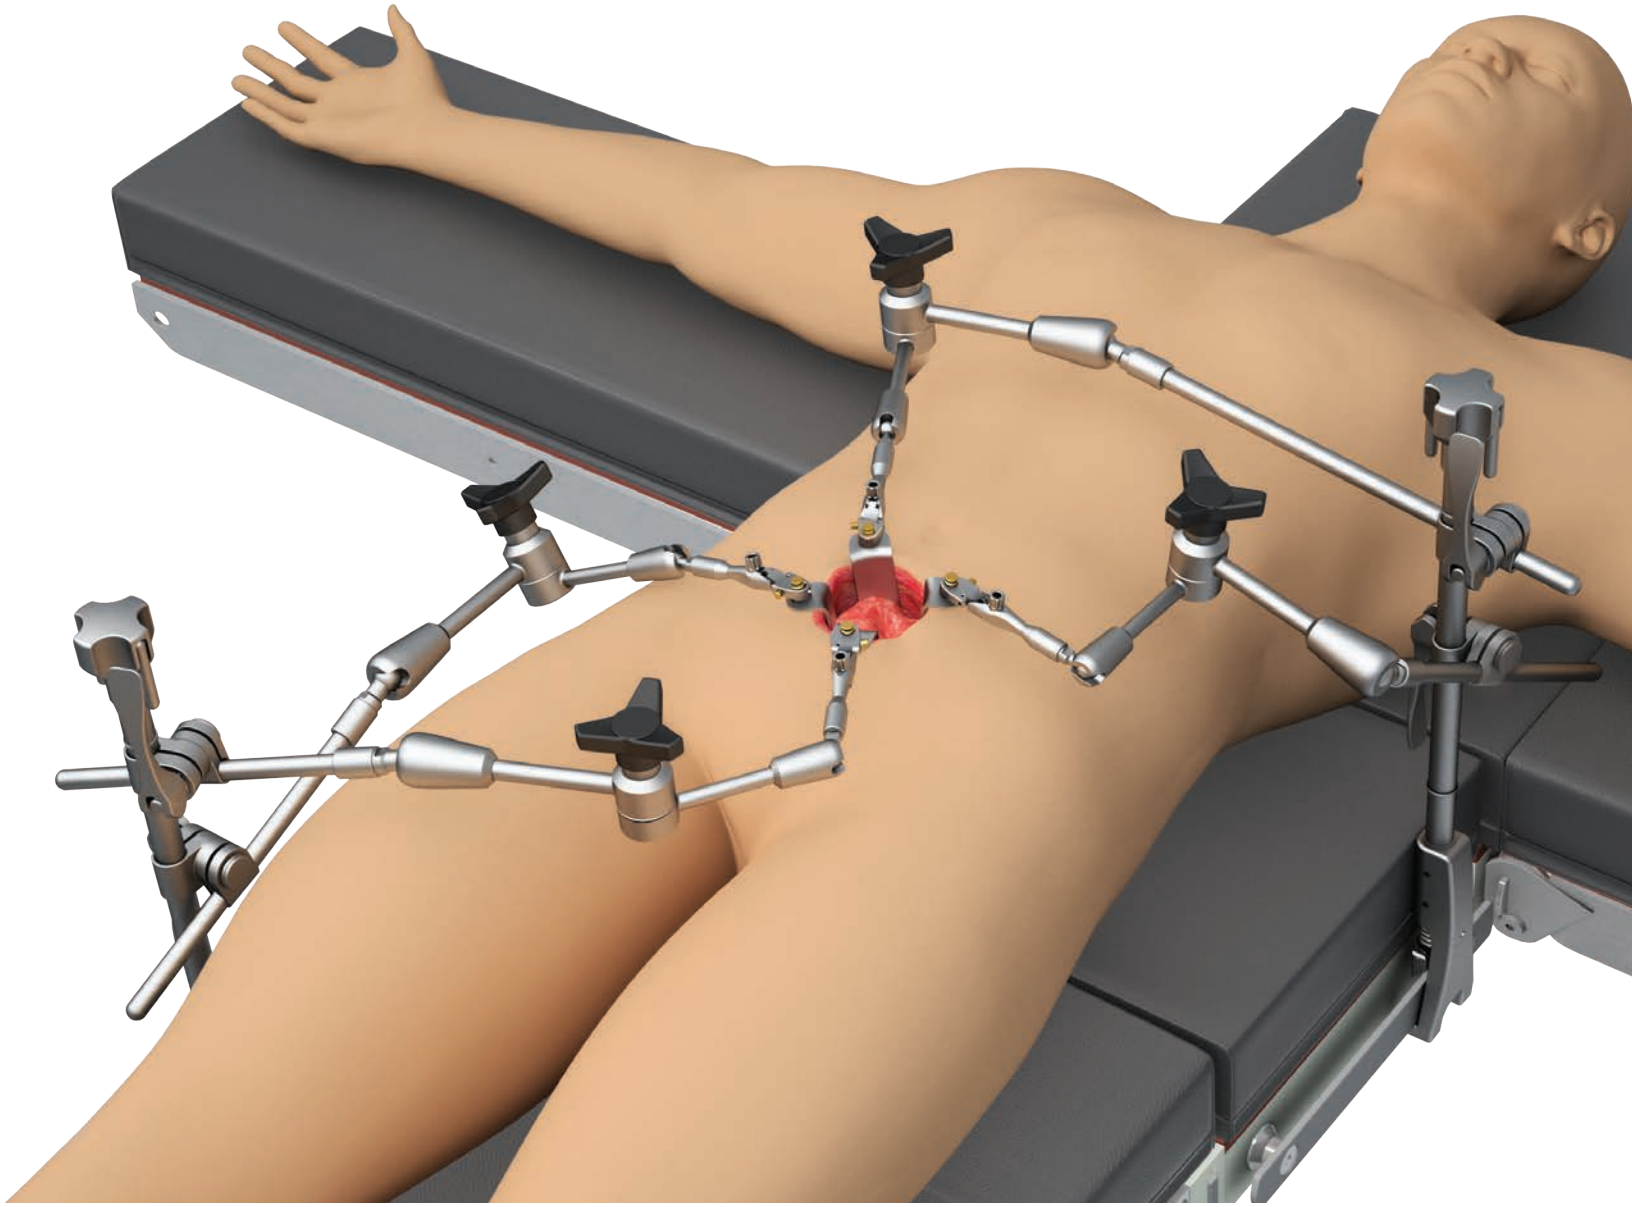

Руководство пользователя системы артикуляционного рукава Thompson ALIF:

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ АРТИКУЛЯЦИОННОГО РУКАВА THOMPSON ALIF

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Инструкции по установке каркаса

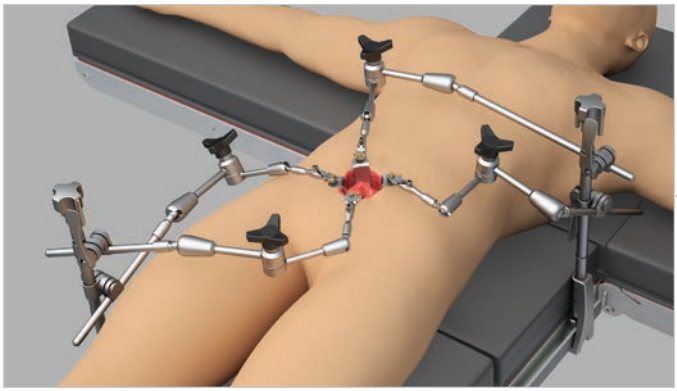

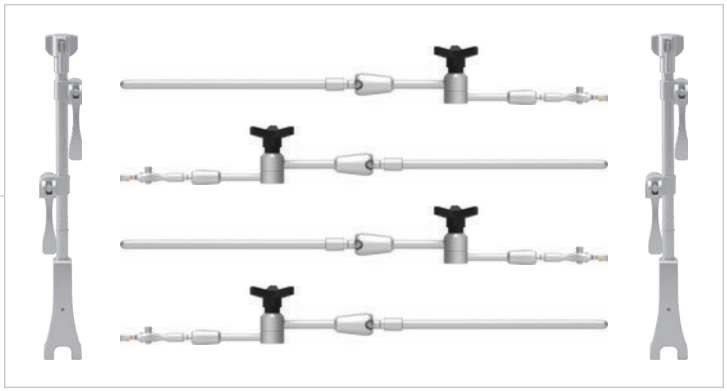

ВНИМАНИЕ: Избегайте сжатия тела пациента элементами каркаса во избежание повреждения нервов.

Thompson Retractor поставляется нестерильным. Указания по очистке, стерилизации и уходу см. в инструкции по эксплуатации Thompson Retractor.

Дополнительные предупреждения и предостережения см. в инструкции по эксплуатации Thompson Retractor.

Информация о других системах Thompson Retractor указана в их соответствующих руководствах пользователя.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ JACKSON: АДАПТЕР КАРКАСА JACKSON

Положите адаптер каркаса Jackson на стол и поверните ручку по часовой стрелке для затяжки. После фиксации можно добавить зажим для крепления к поручням Thompson.

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер каркаса Jackson предназначен только для крепления ретракторов Thompson Retractor. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение с другими ретракторами из-за возможной несовместимости.

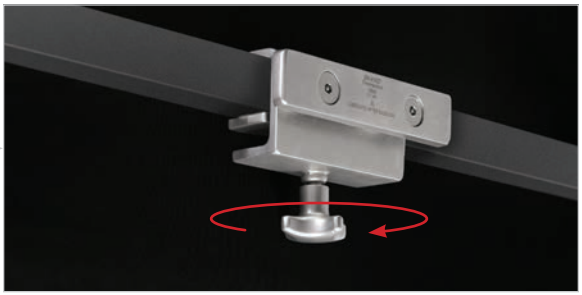

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЖИМОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОРУЧНЯМ

Поместите Elite Rail Clamp на поручень, покрытый стерильной простыней, около подмышечной впадины пациента рядом с подлокотником и затяните зажим вращением верхней ручки по часовой стрелке. Повторите эту операцию на другой стороне стола около верхней части бедра, на 25–30 см ниже средней точки разреза.

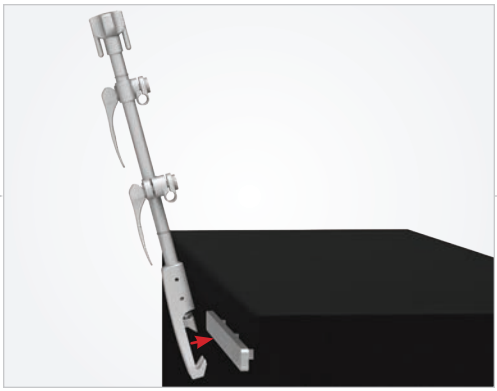

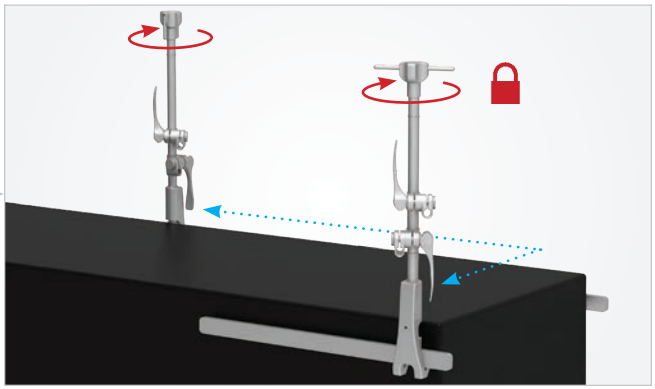

Инструкции по установке каркаса *(продолжение)*

ПРИСОЕДИНЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ РУКАВОВ

Когда шарнир зажима для крепления к поручням не зафиксирован, вставьте артикуляционный рукав в шарнир зажима для крепления к поручням и установите его в нужное положение. Зафиксируйте, повернув кулачок-упор. Повторите в отношении остальных рычагов.

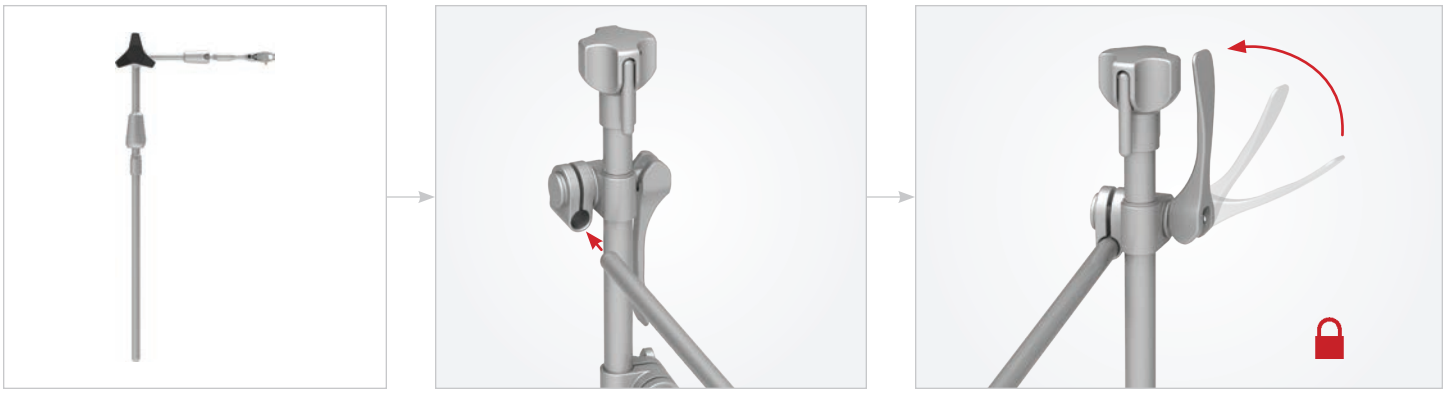

РЕГУЛИРОВКА АРТИКУЛЯЦИОННЫХ РУКАВОВ

Чтобы отрегулировать рычаг, поверните черную ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление, отрегулируйте по мере необходимости и поверните черную ручку по часовой стрелке, чтобы затянуть ее и зафиксировать положение рычага.

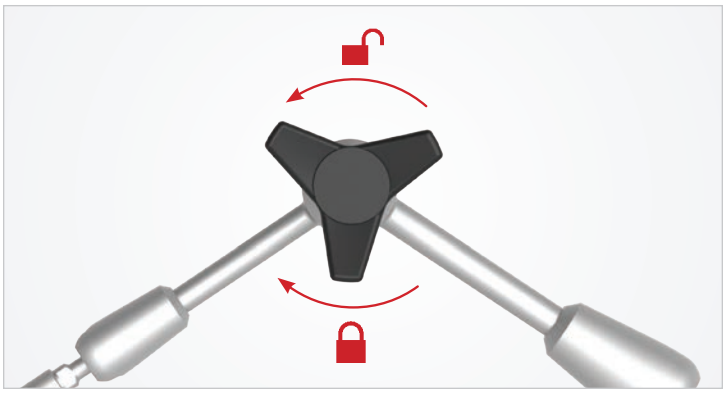

Присоединение и регулировка ретракторов

S-LOCK®

Прикрепите ретрактор к рукоятке, нажав на плунжер и вставив штырь ретрактора. Нажмите на плунжер, чтобы освободить ретрактор и переключиться между положениями «повернуть» и «закрепить».

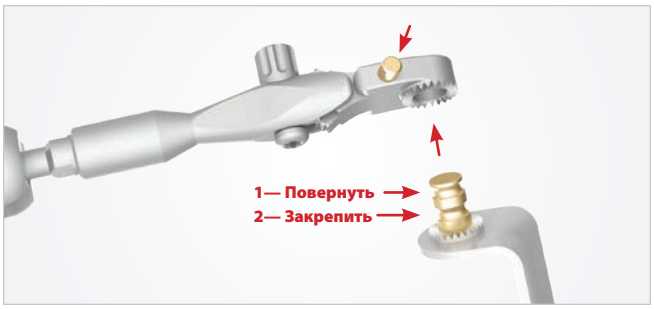

БЫСТРОЕ УГЛОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Пластины можно установить под углом 45º вверх или вниз вручную или при помощи Т-образной рукоятки.

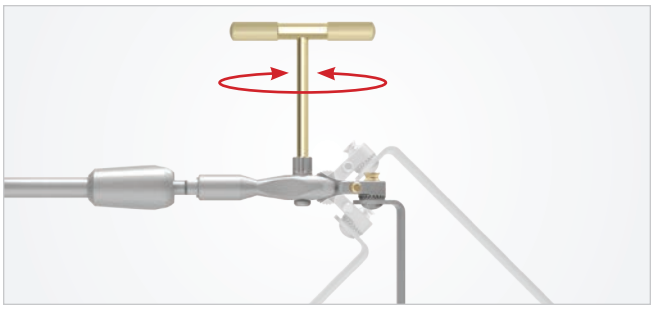

Телефон для ответов на вопросы или получения дополнительной информации:

+1 231 922 0177

Rev A
041822
alaaum-**ru**

Uncompromised Exposure

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684, США
телефон: +1 231 922 0177
факс: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
НИДЕРЛАНДЫ

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® и логотип «T Circle» являются зарегистрированными товарными знаками Thompson Surgical Instruments, Inc.

Патенты: trpat.com

Примечание: Так как мы постоянно оптимизируем качество продукции, некоторые из полученных вами изделий могут немного отличаться от их изображений в этом документе.

Made In USA