Thompson Retractor

NOUVEAUTÉ **Poignées clipsables d'inclinaison libre et de double inclinaison**

FRANÇAIS

La poignée d'inclinaison libre permet un positionnement tactile de la lame

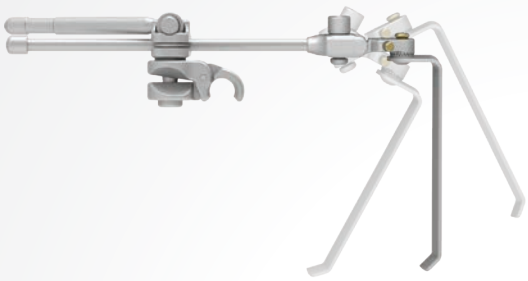

1. Positionnement tactile de la lame



2. Micro-ajustements du mécanisme d'inclinaison rapide

La poignée de double inclinaison permet également d'effectuer des micro-ajustements précis de l'inclinaison des lames

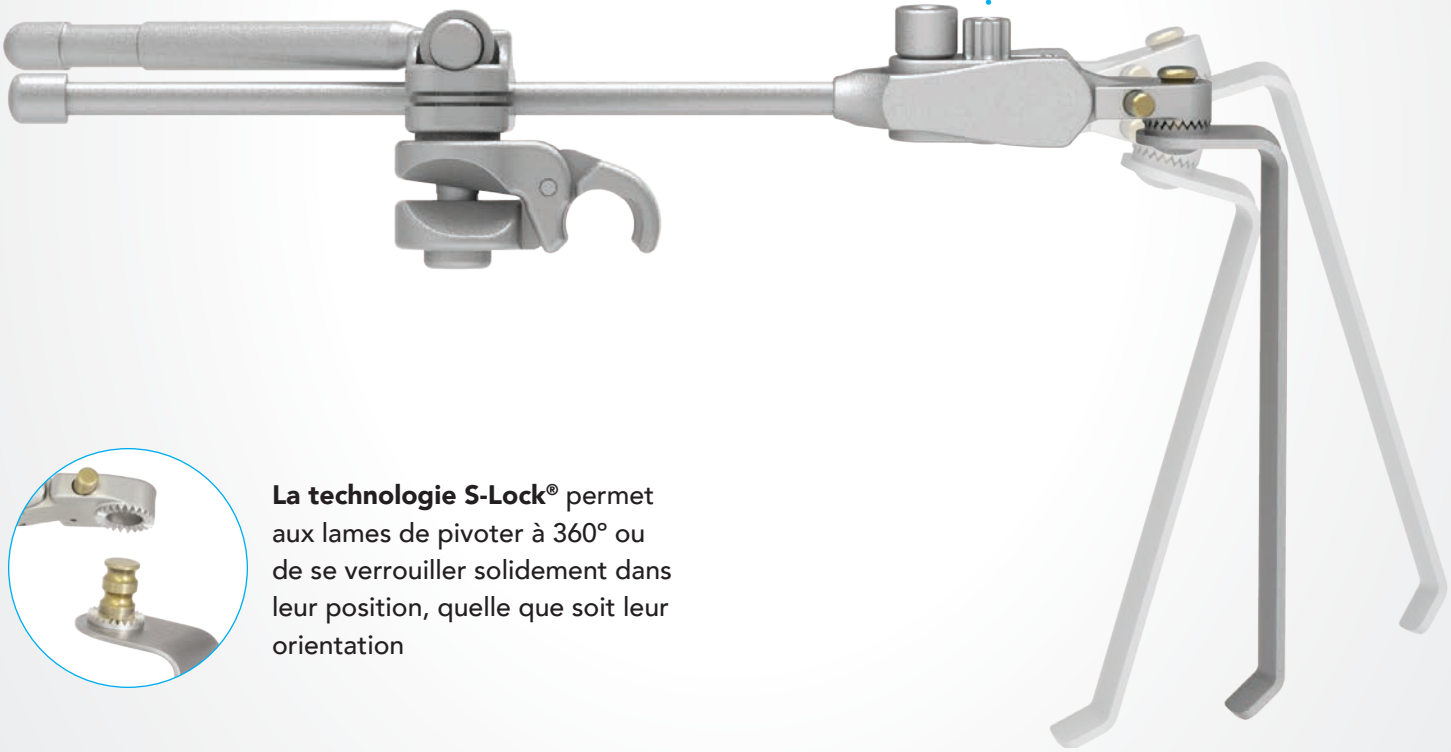

La technologie S-Lock® permet aux lames de pivoter à 360° ou de se verrouiller solidement dans leur position, quelle que soit leur orientation

INFORMATIONS DE COMMANDE :

Poignée clipsable d'inclinaison libre Cam II de 20 cm (8") n° SL42126WFP
Poignée clipsable de double inclinaison Cam II de 20 cm (8") n° SL42126WDP
Outil hexagonal avec poignée en T n° 60021

Instructions d'utilisation à la page suivante...

QUESTIONS OU INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
+1 231 922 0177 / THOMPSONSURGICAL.COM

POIGNÉES D'INCLINAISON LIBRE

Les lames peuvent être inclinées librement en plaçant l'outil hexagonal dans le mécanisme d'inclinaison libre et en positionnant la lame à l'endroit désiré. Serrer le mécanisme pour fixer la lame dans sa position en tournant l'outil hexagonal dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela peut être fait avant ou après la fixation de la poignée sur le cadre.

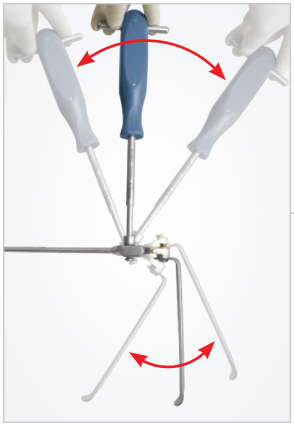

POIGNÉES DE DOUBLE INCLINAISON

Après avoir positionné et serré la lame à l'aide du mécanisme d'inclinaison libre comme décrit dans l'étape précédente, une inclinaison précise supplémentaire peut être obtenue en utilisant l'outil hexagonal pour faire tourner le mécanisme d'inclinaison rapide nervuré vers le haut ou vers le bas.

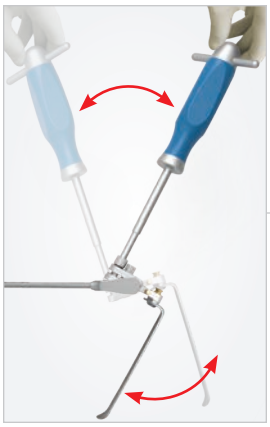

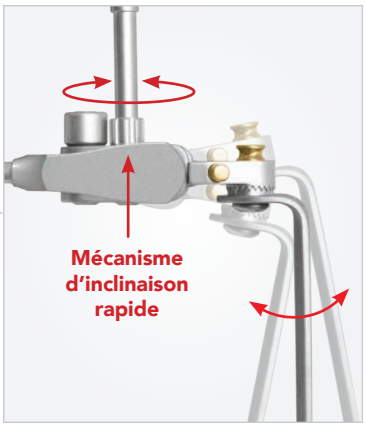

Poignées + lames S-LOCK®

Fixer la lame à la poignée en appuyant sur le piston et en insérant le raccord fileté de la lame. Appuyer sur le poussoir pour libérer la lame et changer la position (« pivotante » ou « verrouillée »).

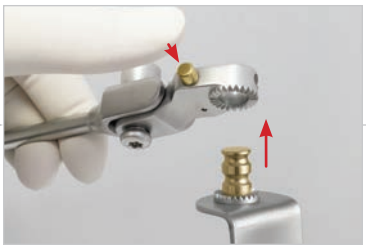

FIXATION DES POIGNÉES CLIPSABLES

L'articulation étant en position déverrouillée, clipser au cadre à l'endroit désiré, positionner la lame dans l'incision, et retourner la poignée du joint à came pour la verrouiller dans sa position.

RETRAIT DES POIGNÉES CLIPSABLES

Retourner la poignée du joint à came en position déverrouillée, pincer l'arrière du joint à came avec le pouce et l'index, et soulever doucement du bras.



Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
téléphone: +1 231 922 0177
fax: +1 231 922 017
thompsonsurgical.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye
PAYS-BAS

CE 0297

© 2019 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ®, PLA® et le logo Thompson représentant un T dans un cercle sont des marques déposées de Thompson Surgical Instruments, Inc.
Brevets : US4971038, US5025780, US5888197, US5897087, US5902233, US5984865, US6033363, US6416465, US6511423, US7338442, US7749163, US8257255, US8360971, US8617064, US9872675. Autres brevets en attente.

Rév. A
042419
cofadassum-fr

Légende des symboles :

Fabricant	Mandataire établi dans l'Union européenne	Marquage CE	Avertissements / précautions	Non stérile

Made In USA