Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

Thompson大腿骨エレベーター ユーザーマニュアル：

THOMPSON大腿骨エレベーターのセットアップ手順

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

大腿骨エレベーターのセットアップ手順

Thompson Retractor

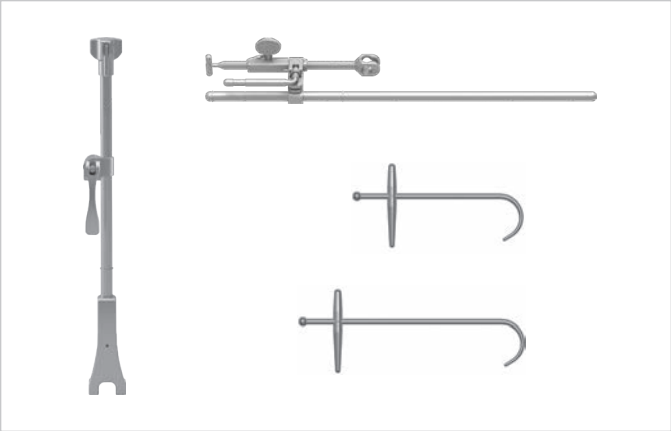

注意：神経の損傷を防ぐため、患者の身体をフレームコンポーネントで圧迫することは避けてください。

Thompson Retractorは、未滅菌の状態で提供されています。洗浄、滅菌およびお手入れの方法については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他の警告と注意については、Thompson Retractorの使用説明書を参照してください。

その他のThompson Retractorシステムについては対応する各ユーザーマニュアルを参照してください。

記号一覧：

製造者	EC REP ECC認定代理人	CE 0297 CEマーク	警告/注意	非滅菌

Hana®テーブル、またはArchなどの脚部位置決めシステムを使用する場合

レールエクステンダーを滅菌ドレープ上に設置し、上部ノブを時計回りに回して締めます。

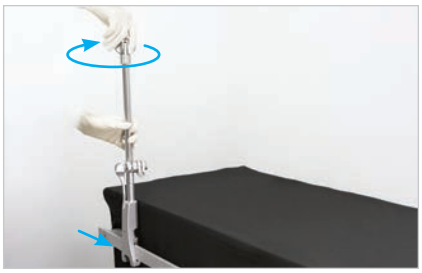

ステップ1：レールクランプ

滅菌ドレープで覆ったレールの上にElite Rail Clampを置いて、上端のノブを時計回りに回転させて固定します。

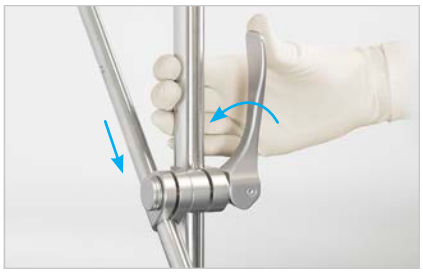

ステップ2：ストレートアーム

ストレートアームをElite Rail Clampのジョイントに挿入して位置を決め、カムジョイントハンドルをフリップさせて固定します。

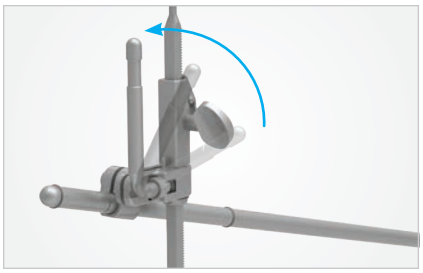

ステップ3：エレベーターハンドル

エレベーターハンドルを配置し、ジョイントを閉じて所定の位置にロックします。

ステップ4：フック

大腿骨フックの近位端にあるT型ハンドルを用いて、フックを所定の位置にセットします。ボールをエレベータアームハンドルに挿入して、所定の位置に保持します。

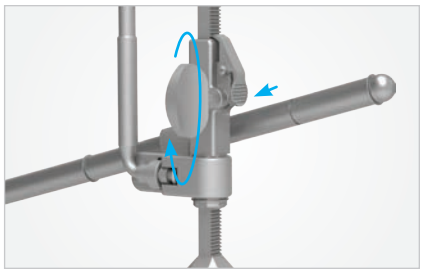

ステップ5：開創

追加で開創する必要がある場合は、微調整ハンドルのノブを回してさらに牽引してください。
爪を押して、開創を解除します。

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
電話番号：+1 231.922.0177
ファックス：+1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
オランダ

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.
® Thompsonの「丸T」ロゴマークは、Thompson Surgical Instruments, Inc.の登録商標です。
特許権利者：trpat.com

Rev A
021822
hipfeum-ja