Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

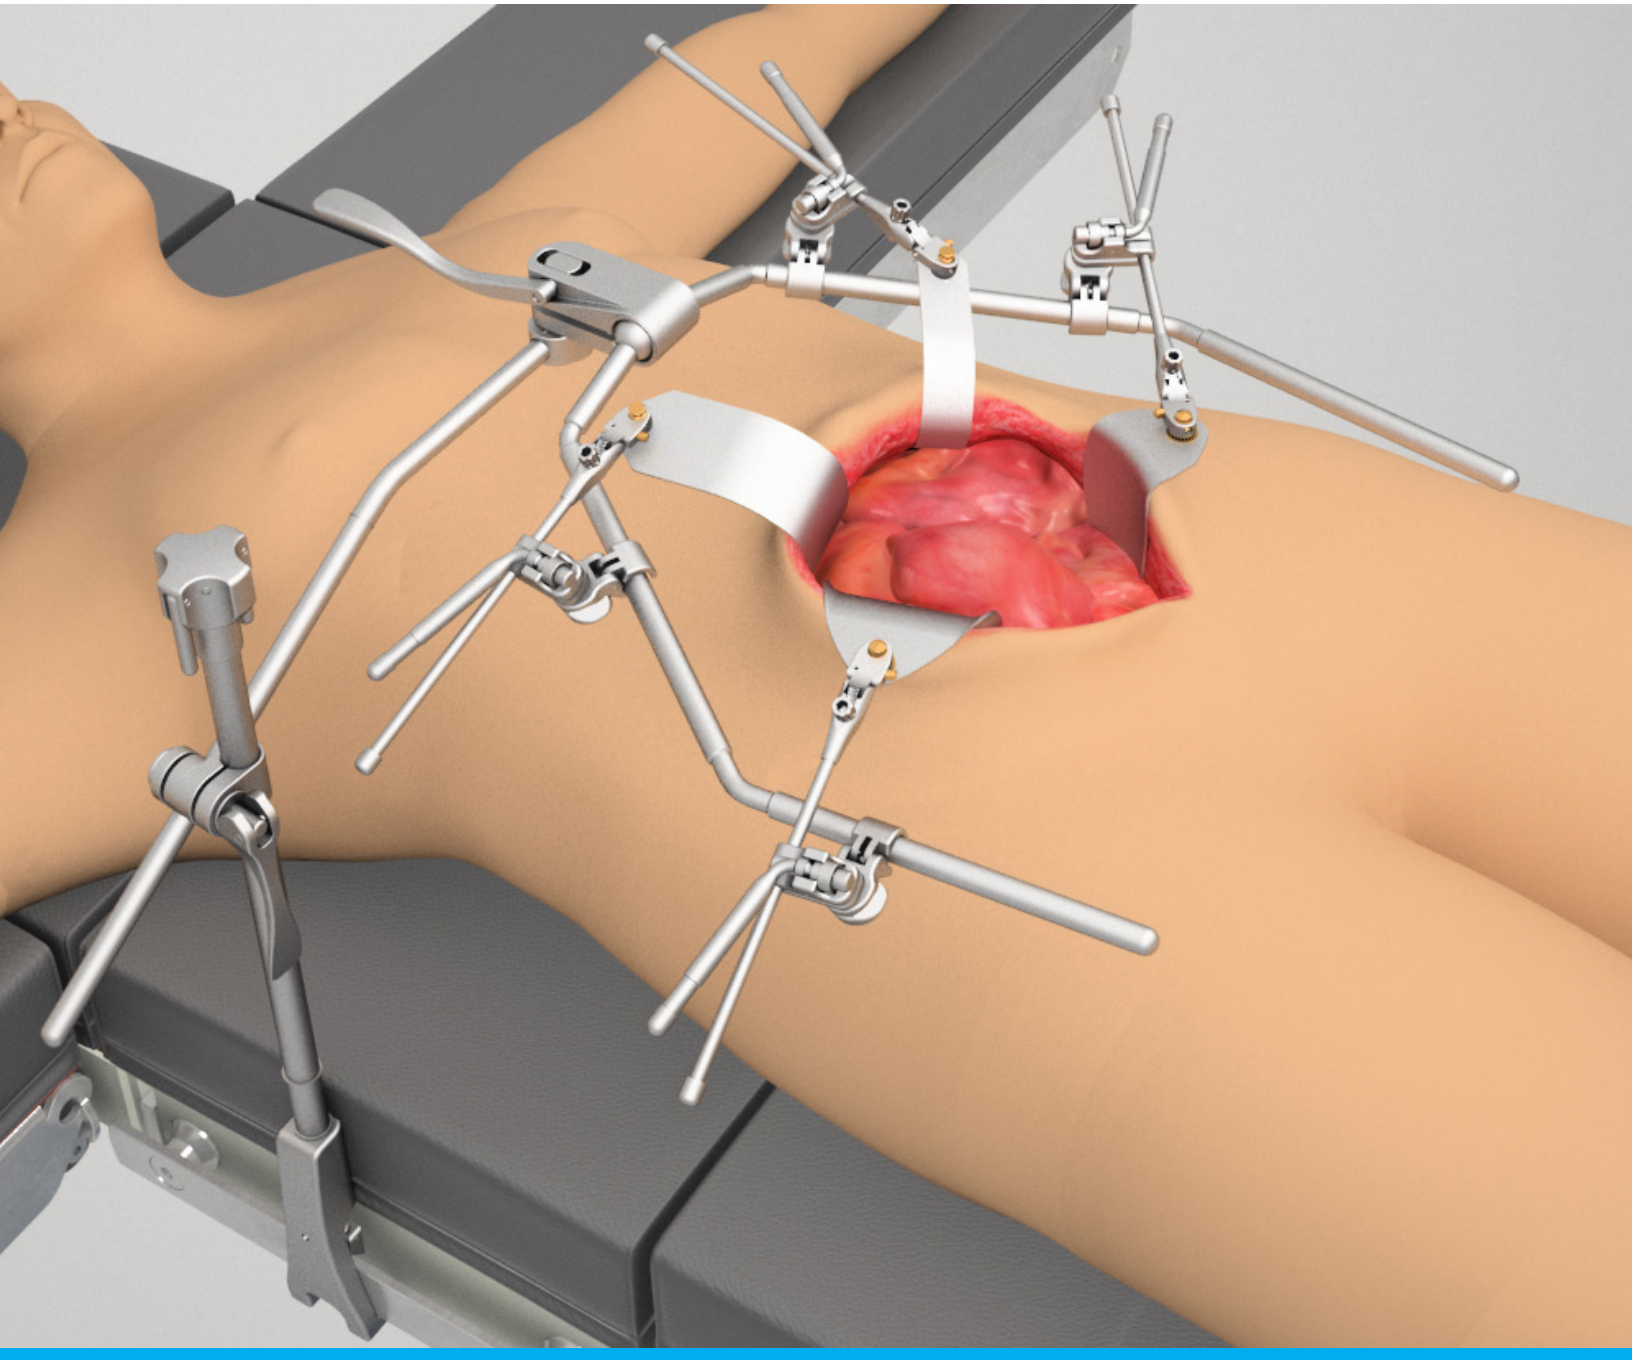

Manuel d'utilisation du Thompson OneFrame™ :

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU THOMPSON ONEFRAME™

Instructions pour l'installation du OneFrame™

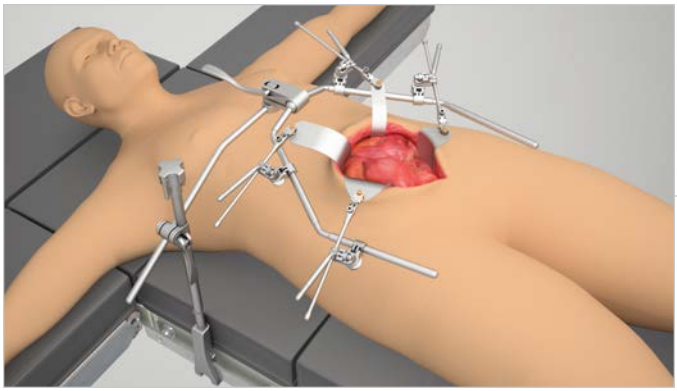

MISE EN GARDE : Éviter de comprimer le corps du patient avec les éléments du cadre afin de prévenir toute lésion nerveuse.

Le Thompson Retractor est fourni non stérile. Consulter le mode d'emploi du Thompson Retractor pour les instructions de nettoyage, de stérilisation et d'entretien.

Consulter le mode d'emploi du Thompson Retractor pour d'autres avertissements et mises en garde.

Pour les autres systèmes Thompson Retractor, se reporter au manuel d'utilisation de chacun d'entre eux.

ÉTAPE 1 : PINCE DE RAIL

Placer l'Elite Rail Clamp sur le rail au-dessus du champ stérile et tourner la molette supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

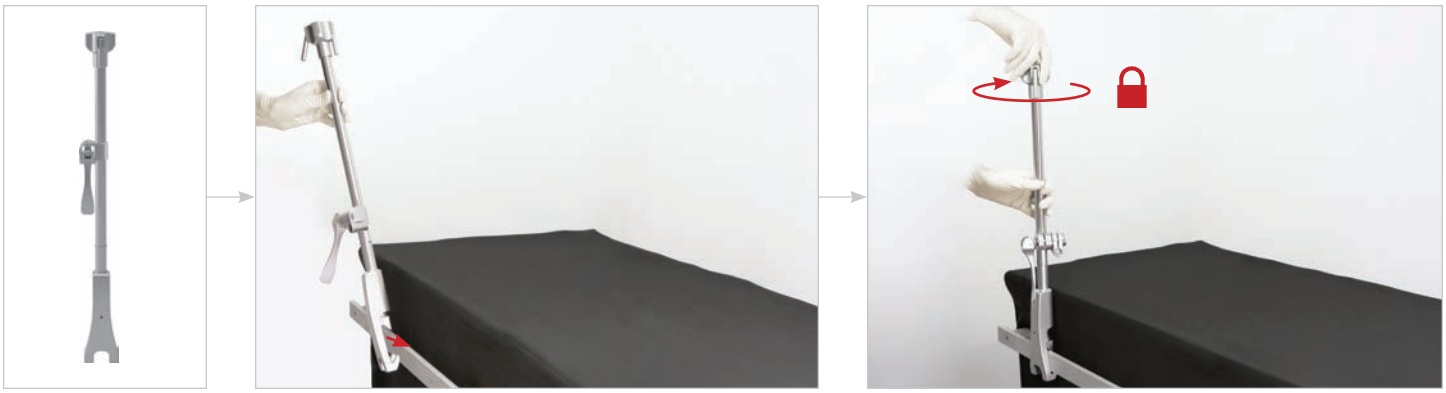

ÉTAPE 2 : ATTACHER LE ONEFRAME™ À L'ELITE RAIL CLAMP

Insérer le bras de support du OneFrame™ dans le joint de l'Elite Rail Clamp, le positionner selon les besoins, et tourner la poignée du joint à came pour le bloquer une fois en place.

Instructions pour l'installation du OneFrame™ (suite)

ÉTAPE 3 : BRAS DU ONEFRAME™

Avec le joint du OneFrame™ en position déverrouillée, ajuster les bras du cadre selon les besoins. Verrouiller une fois en place en tournant le joint de 180° (pour qu'il pointe dans une direction opposée aux bras).

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le produit, NE PAS déplacer les bras du cadre lorsque le joint du cadre est en position verrouillée.

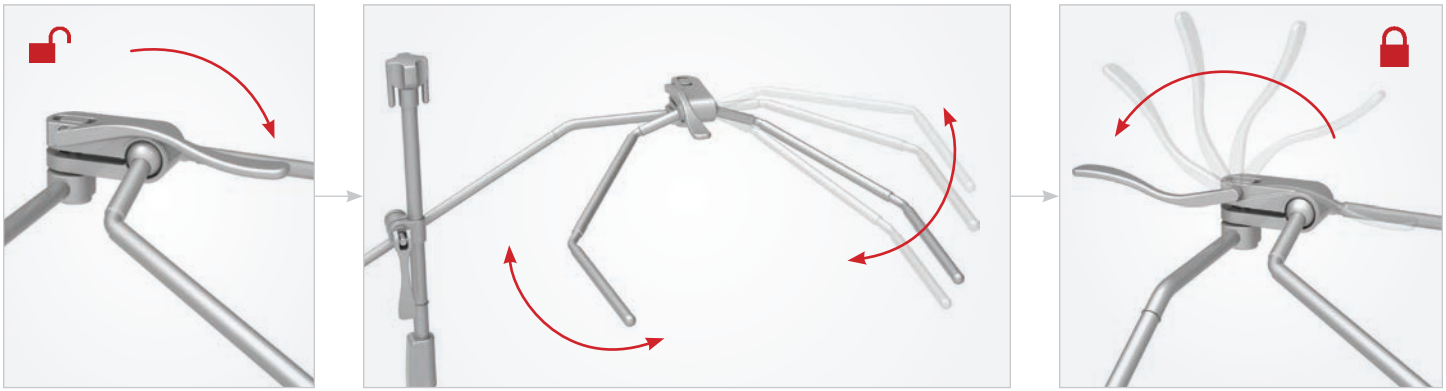

Poignées + lames

FIXATION DES POIGNÉES CLIPSABLES

Le joint étant en position déverrouillée, clipser au cadre à l'endroit désiré, positionner la lame dans l'incision, et retourner la poignée du joint à came pour la verrouiller dans sa position.

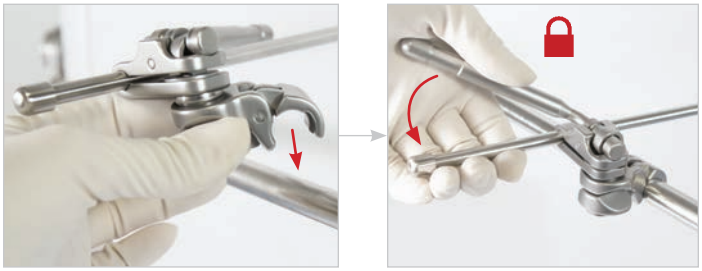

RETRAIT DES POIGNÉES CLIPSABLES

Retourner la poignée du joint à came en position déverrouillée, pincer l'arrière du joint à came avec le pouce et l'index, et soulever doucement du bras.

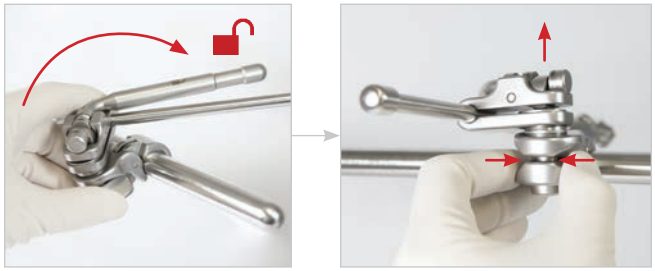

POIGNÉES + LAMES S-LOCK®

Fixer la lame à la poignée en appuyant sur le piston et en insérant le raccord fileté de la lame. Appuyer sur le piston pour libérer la lame et passer de la position « pivotante » à la position « verrouillée ».

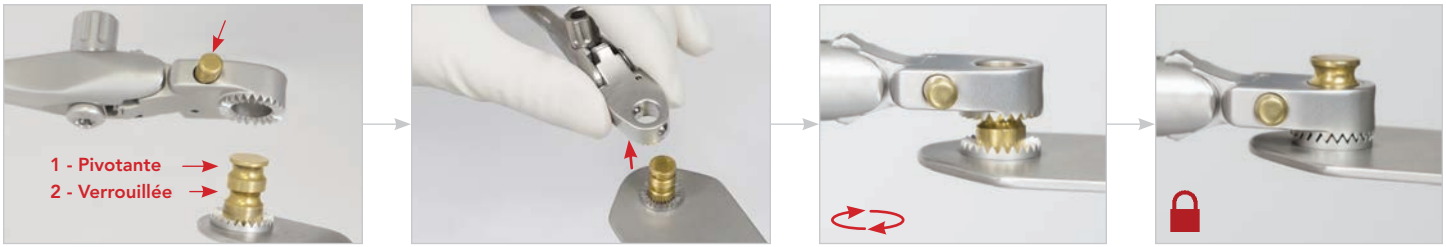

POIGNÉES D'INCLINAISON RAPIDE

Les lames peuvent être inclinées de 45° vers le haut ou vers le bas manuellement ou avec la poignée en T.

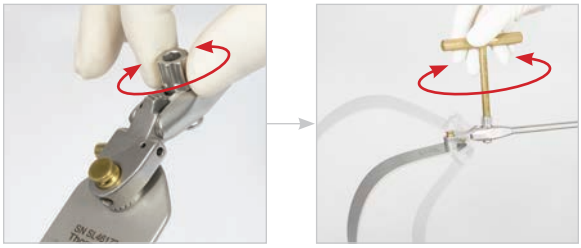

POIGNÉES MICRO-ADJUSTABLE

Rétracter davantage les lames en tournant la molette de la poignée Micro-Adjustable dans le sens des aiguilles d'une montre. Relâcher la tension en appuyant sur le cliquet.

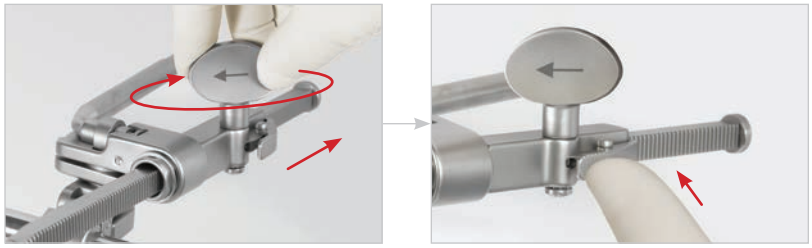

Pour toute question ou information complémentaire :

+1 231 922 0177

Rev. B
042921
tofum-fr

Uncompromised Exposure

VISITEZ NOTRE SITE : **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
téléphone: +1 231.922.0177
fax: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye
PAYS-BAS

© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock®, PLA® et le logo représentant un T dans un cercle sont des marques déposées de Thompson Surgical Instruments, Inc.

™ OneFrame™ est une marque commerciale de Thompson Surgical Instruments, Inc.

Brevets : trpat.com

Légende des symboles :

Fabricant	EC REP Mandataire établi dans l'Union européenne	CE 0297 Marquage CE	Avertissements/précautions	Non stérile

CE 0297

Made In USA