Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

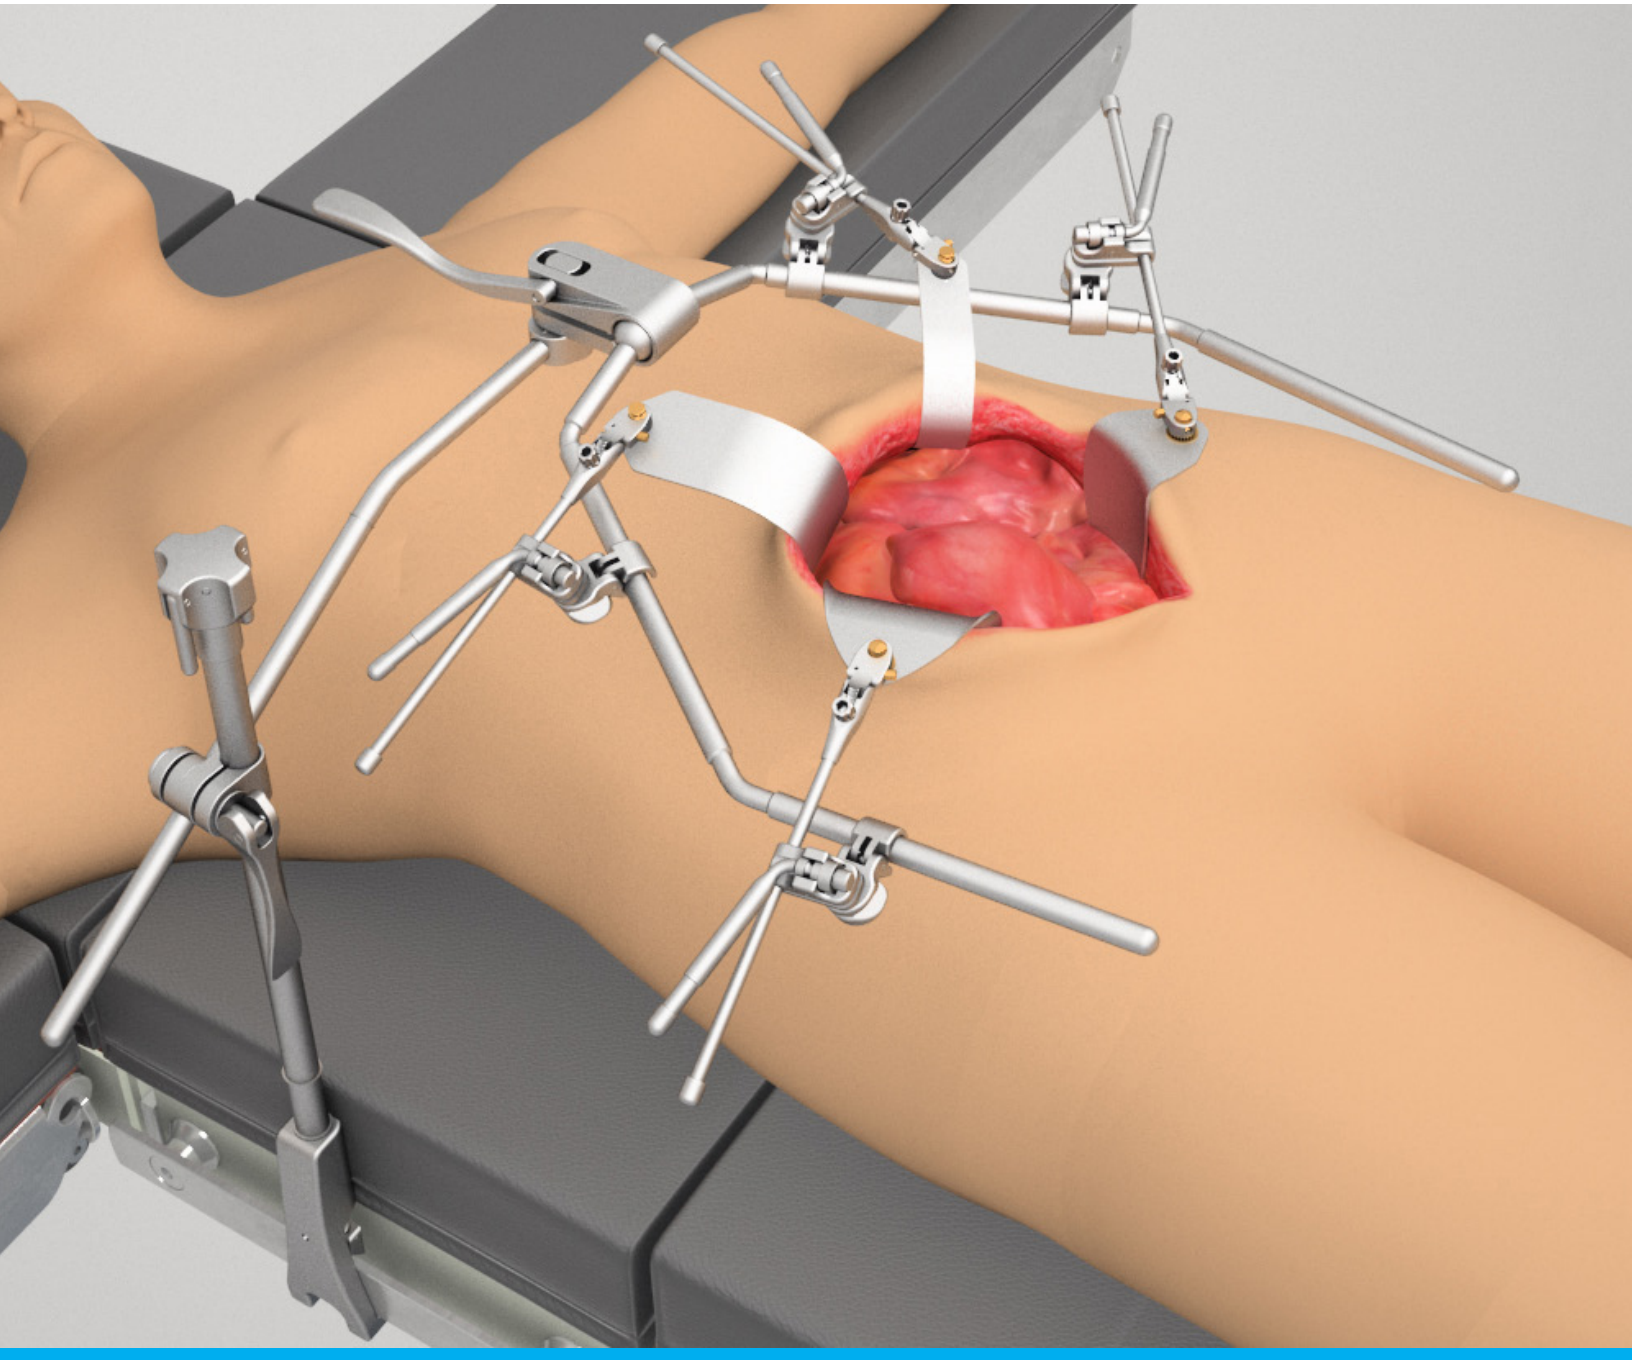

# Manuale dell'utente di Thompson OneFrame™:

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER THOMPSON ONEFRAME™

# Istruzioni per l'installazione di OneFrame™

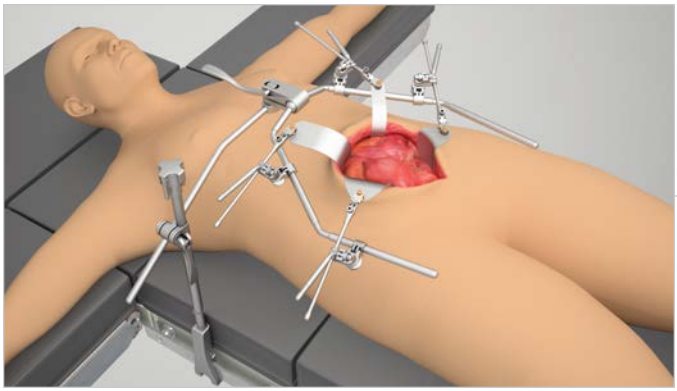

**ATTENZIONE: Per prevenire lesioni dei nervi, evitare di comprimere il corpo del paziente con componenti del telaio.**

**Thompson Retractor è fornito non sterile. Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del Thompson Retractor per le istruzioni di pulizia, sterilizzazione e cura.**

**Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del Thompson Retractor per ulteriori avvertenze e precauzioni.**

**Per altri sistemi Thompson Retractor, fare riferimento al manuale dell'utente di ognuno di essi.**

## PASSAGGIO 1: CLAMP PER BINARIO

Collocare Elite Rail Clamp sul binario sopra il telo sterile e serrare ruotando la manopola superiore in senso orario.

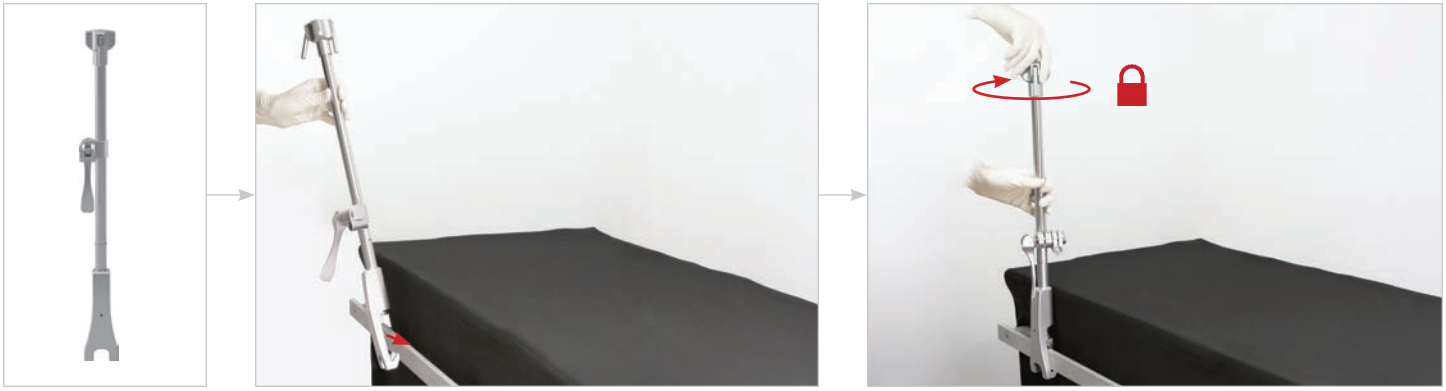

## PASSAGGIO 2: COLLEGARE ONEFRAME™ A ELITE RAIL CLAMP

Inserire il braccio di supporto OneFrame™ in Elite Rail Clamp, posizionare in base alle proprie preferenze e capovolgere la levetta del giunto a camma per fissare in sede.

## Istruzioni per l'installazione di OneFrame™ (continua)

### PASSAGGIO 3: BRACCI ONEFRAME™

Con il giunto OneFrame™ in posizione sbloccata, regolare i bracci del telaio in base alle proprie preferenze. Bloccare in sede capovolgendo il giunto di 180° (puntandolo in direzione opposta rispetto ai bracci).

**NOTA: Per evitare di danneggiare il prodotto, NON spostare i bracci del telaio con il giunto del telaio in posizione bloccata.**

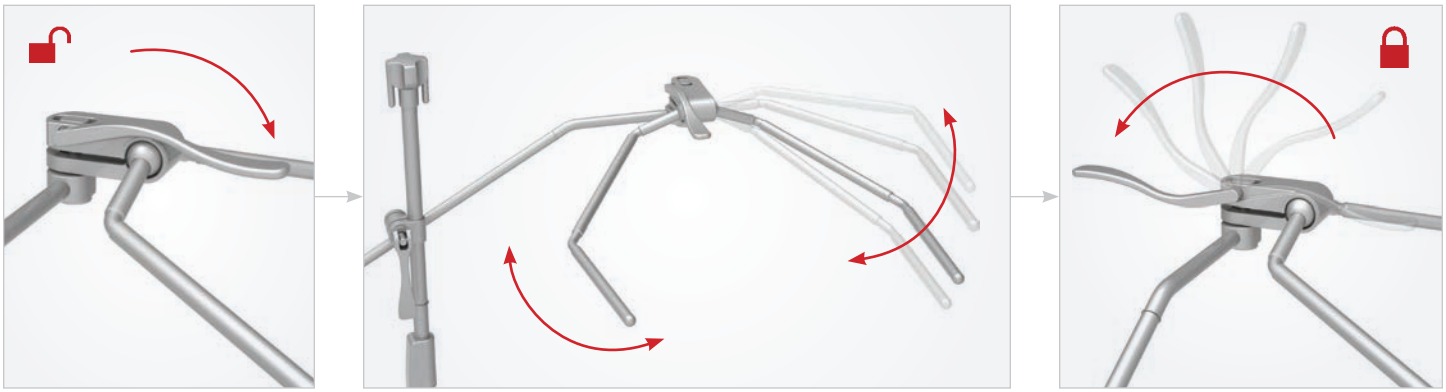

## Impugnature + Lame

### TERMINALE IMPUGNATURA A CLIP

Con il giunto in posizione sbloccata, fissare al telaio nel punto desiderato, posizionare la lama nell'incisione e bloccare in sede capovolgendo la levetta del giunto a camma.

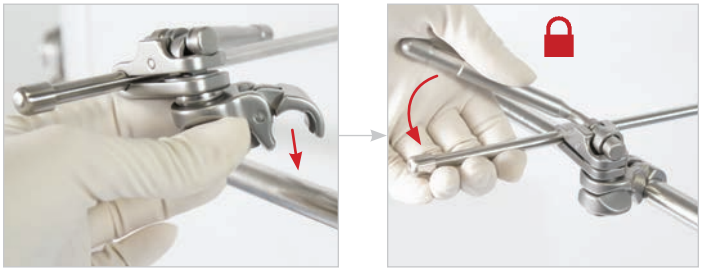

### RIMOZIONE DELL'IMPUGNATURA A CLIP

Capovolgere la levetta del giunto a camma in posizione sbloccata, stringere il giunto a camma con il pollice e l'indice e rimuoverlo con cautela dal braccio sollevandolo.

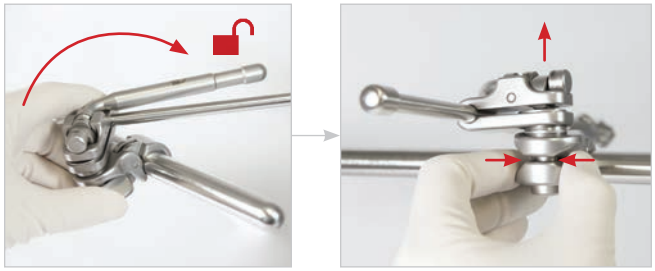

### IMPUGNATURE + LAME S-LOCK®

Collegare la lama all'impugnatura spingendo lo stantuffo e inserendo il nipplo della lama. Spingere lo stantuffo per rilasciare la lama e passare dalla posizione "girevole" a "bloccato".

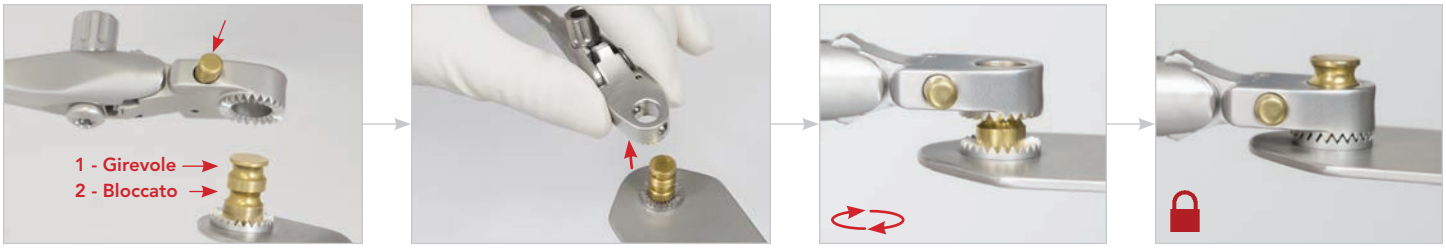


### IMPUGNATURE AD ANGOLO RAPIDO

Le lame possono essere inclinate di 45° verso l'alto o verso il basso a mano o con l'impugnatura a T.

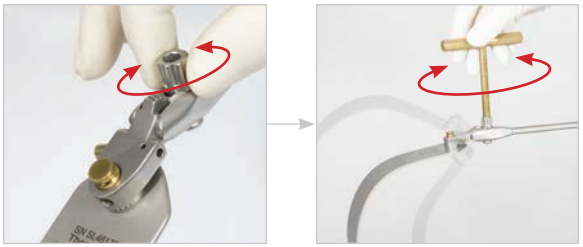

### IMPUGNATURE MICRO-ADJUSTABLE

Ritrarre ulteriormente le lame ruotando la manopola dell'impugnatura Micro-Adjustable in senso orario. Rilasciare la tensione premendo il dente d'arresto.

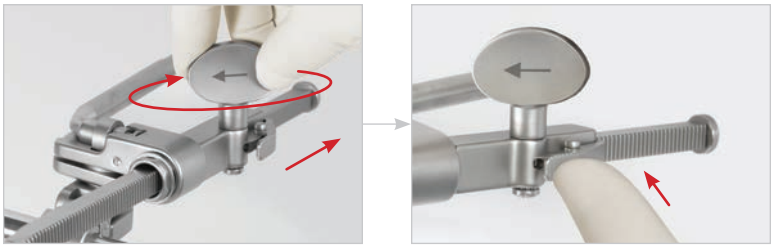

Domande o ulteriori informazioni:

**+1 231 922 0177**

Rev B
042921
tofum-it

Uncompromised Exposure

VISITA IL NOSTRO SITO ONLINE: **THOMPSONSURGICAL.COM**


Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
telefono: +1 231.922.0177
fax: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAESI BASSI



© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock®, PLA® e il logomarchio "T Circle" sono marchi commerciali registrati di Thompson Surgical Instruments, Inc.

™ OneFrame™ è un marchio commerciale di Thompson Surgical Instruments, Inc.

Brevetti: trpat.com


**Spiegazione dei simboli:**

| Produttore | EC REP Mandatario nella CE | CE 0297 Marchio CE | Avvertenze/precauzioni | Non sterile |
|---|---|---|---|---|

CE 0297

Made In USA