Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

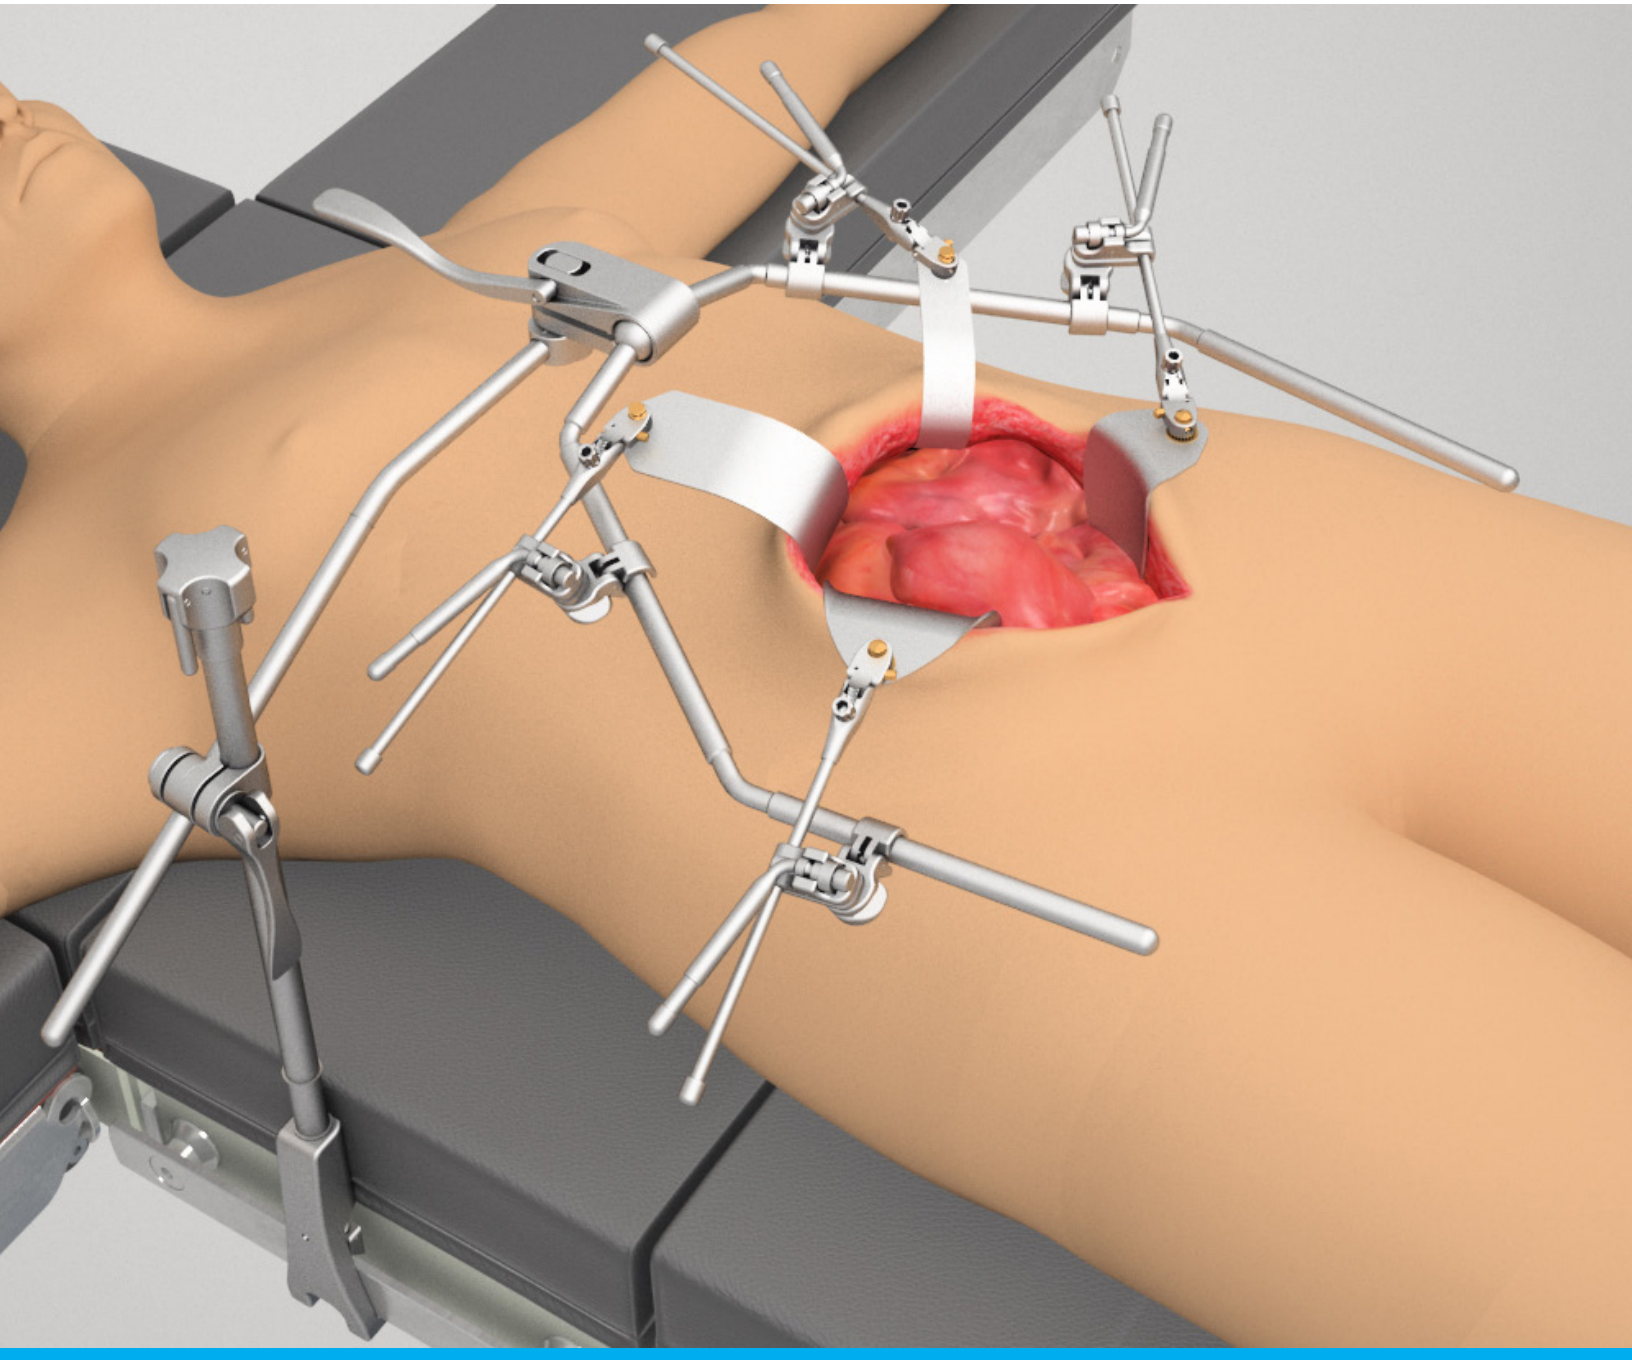

Thompson OneFrame™ 用户手册：

Thompson OneFrame™ 设置说明

OneFrame™ 设置说明

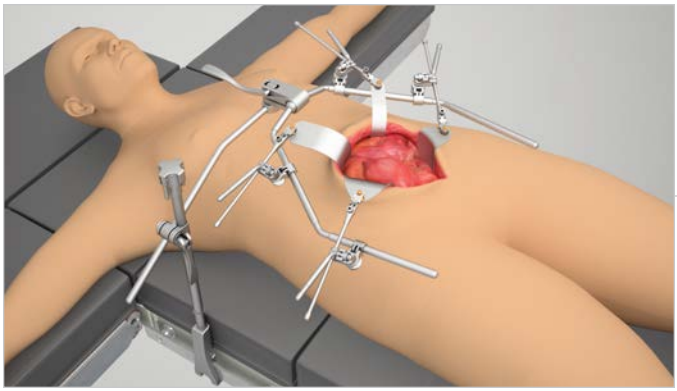

小心：避免用框架部件压迫患者的身体，以防止神经损伤。

Thompson Retractor 以非无菌条件供货。请参阅 Thompson Retractor 使用说明以了解清洁、灭菌和保养说明。

参考 Thompson Retractor 使用说明以了解更多警告和小心的信息。

有关其他 Thompson Retractor 系统，请参考每个系统相应的用户手册。

第 1 步：导轨夹

将 Elite Rail Clamp 放置在无菌铺巾上方的导轨上，并沿顺时针方向旋转顶部旋钮以拧紧。

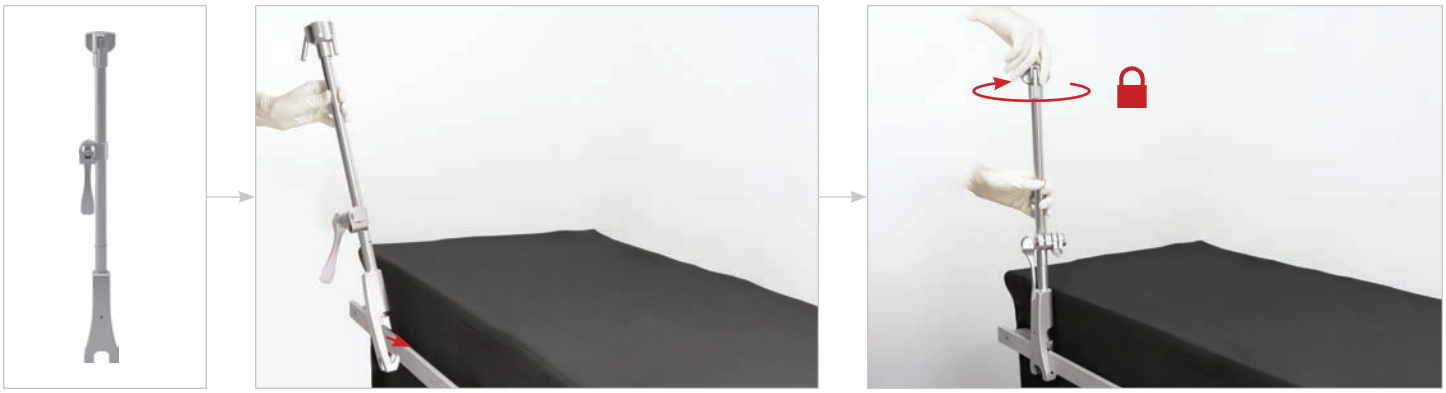

第 2 步：将 OneFrame™ 连接到 Elite Rail Clamp

将 OneFrame™ 支撑臂插入 Elite Rail Clamp 上的接头，根据需要放置，翻转凸轮接头手柄以固定到位。

OneFrame™ 设置说明（续）

第 3 步：ONEFRAME™ 臂

在 OneFrame™ 接头处于解锁位置的情况下，根据需要调整框架臂。通过将接头翻转 180°（朝远离臂的方向）来锁定到位。

注：为避免损坏产品，请勿在框架接头处于锁定位置时移动框架臂。

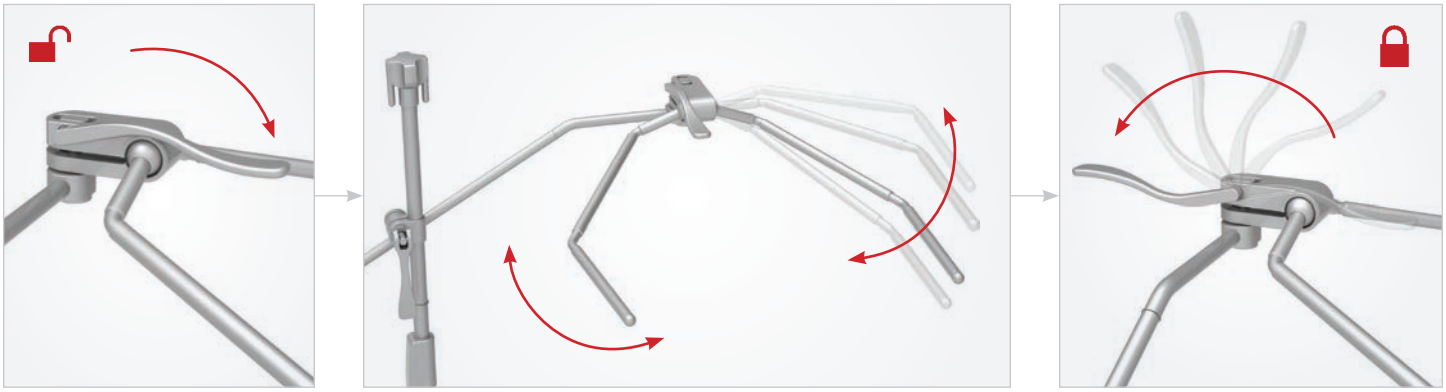

手柄与叶片

卡入式手柄的安装

在接头处于解锁位置的情况下，将其卡到框架上所需的位置，将叶片置于切口内，然后翻转凸轮接头手柄将其锁定到位。

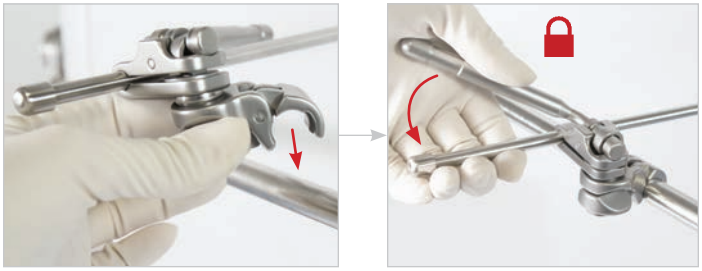

卡入式手柄的拆卸

将凸轮接头手柄翻转到解锁位置，用拇指和食指捏住凸轮接头的后部，然后轻轻向上拉离框架臂。

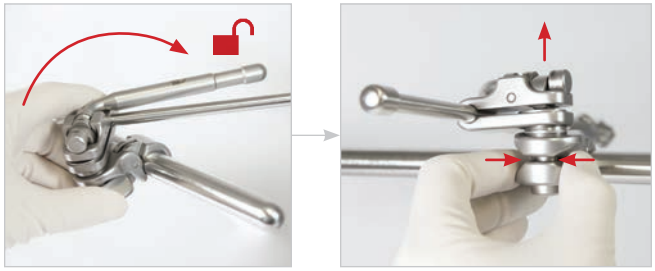

S-LOCK® 手柄与叶片

按下柱塞并插入叶片凸头，将叶片安装到手柄上。按下柱塞释放叶片，即可在“旋转”和“锁定”位置之间切换。

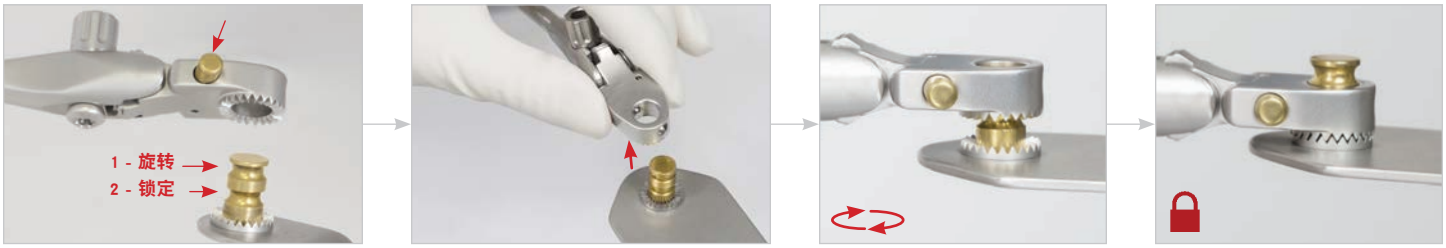

快速变角手柄

可以用手或用 T 形手柄将叶片向上或向下倾斜 45°角。

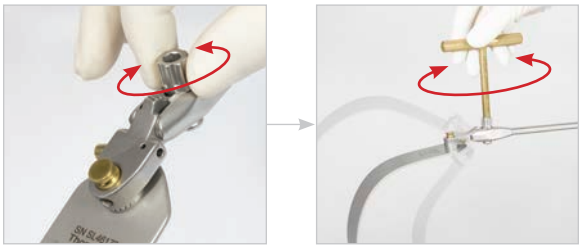

MICRO-ADJUSTABLE 手柄

顺时针转动 Micro-Adjustable 手柄旋钮，进一步牵开叶片。按下棘爪释放张力。

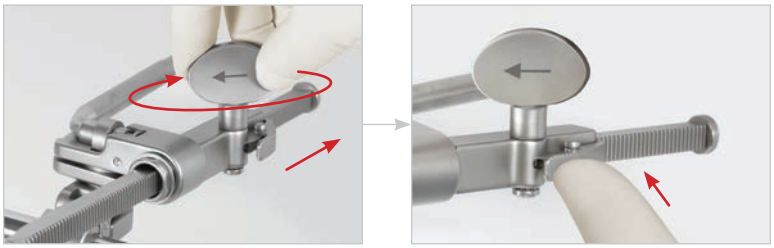

问题或其他信息：

+1 231 922 0177

版本 B
042921
tofum-zh

Uncompromised Exposure

访问我们的网站：THOMPSONSURGICAL.COM

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
电话: +1 231.922.0177
传真: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
荷兰

© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® ®、PLA® 和"T Circle"徽标是 Thompson Surgical Instruments, Inc. 的注册商标。

™ OneFrame™ 是 Thompson Surgical Instruments, Inc. 的商标。
专利信息：trpat.com

符号说明：

制造商	EC REP 授权欧共体代表	CE 0297 CE 标记	警告/注意事项	非无菌

CE 0297

Made In USA