Thompson Retractor

FRANÇAIS

Poignées et lames S-Lock®

Passer à une Uncompromised Exposure avec la technologie S-Lock®

Les poignées et les lames d'écarteurs S-Lock® permettent un positionnement précis des écarteurs sans mouvement ou rotation indésirable pour assurer un écartement stable dans n'importe quel plan. Le mécanisme pivotant verrouillable est simple et facile à utiliser et permet de réduire le temps passé à repositionner les lames.

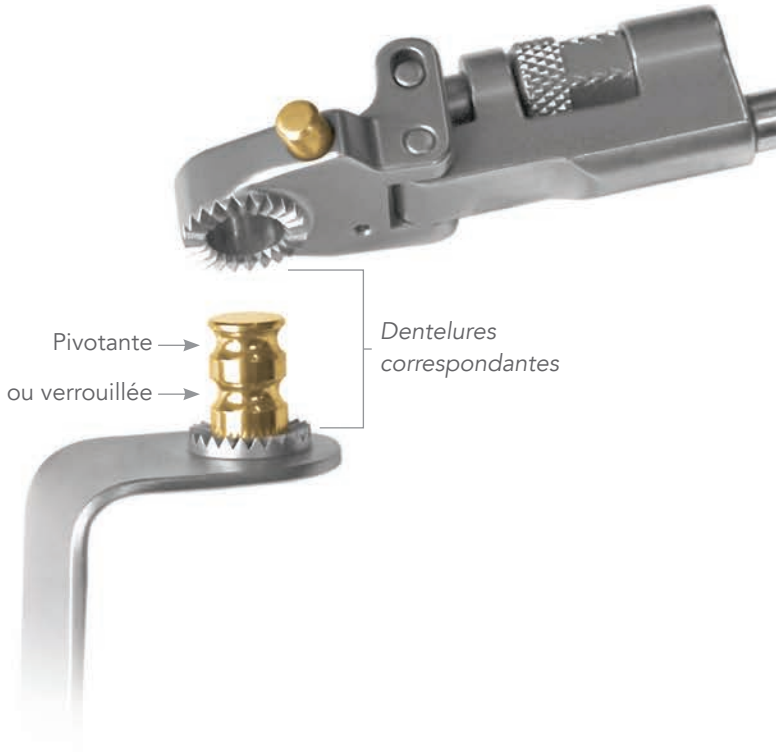

Changer facilement de position (« pivotante » ou « verrouillée ») en appuyant sur un poussoir, sans perte d'écartement.

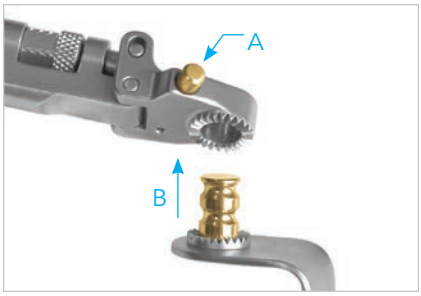

Fixation des lames S-Lock®

Fixer la lame à la poignée en appuyant sur le poussoir doré (A) et en insérant le mamelon de la lame (B).

Position pivotante

Relâcher le poussoir avec la poignée au niveau de la position « pivotante » du mamelon et la faire pivoter dans la position souhaitée.

Position verrouillée

Verrouiller la lame S-Lock dans sa position au niveau de la position « verrouillée » du mamelon en appuyant à nouveau sur le poussoir et en appuyant sur la poignée vers le bas pour engager les dentelures.

REMARQUE :
les lames peuvent être fixées aux poignées d'écarteurs avant ou après la fixation des poignées d'écarteurs au cadre.

Lames S-Lock® : Faire la distinction entre « SL » et « SO »

Quelle est la différence entre les lames « SL » et « SO » ?

Les lames Thompson « SO » (ou « Swivel Only (Pivotante uniquement) ») ont été conçues pour fonctionner avec les poignées Thompson S-Lock dans une optique de standardisation de nos plateaux afin que toutes les lames soient compatibles avec toutes les poignées. Une lame « SL » ou « SO » nécessite l'utilisation d'une poignée S-Lock. Bien que les lames « SO » ne se verrouillent pas dans leur position comme nos lames « SL », elles sont toujours utilisées avec des poignées S-Lock pour fonctionner de la même manière que nos lames interchangeables.

Les images ci-dessous illustrent la façon dont les lames S-Lock se placent dans leurs positions respectives sur les poignées d'inclinaison S-Lock Cam et Micro-Adjustable. La poignée d'inclinaison Cam II est légèrement plus compacte tandis que la poignée d'inclinaison Micro-Adjustable II est plus robuste.

Poignées d'inclinaison Cam II :

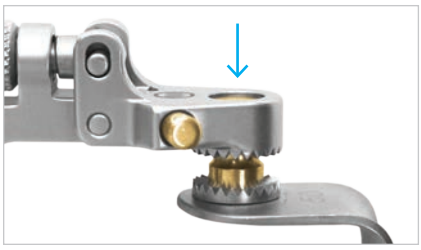

Lame « SL » en position « SWIVEL (PIVOTANTE) »
Le mamelon se trouve juste en dessous de la poignée

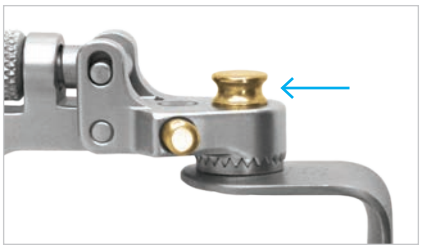

Lame « SL » en position « LOCKED (VERROUILLÉE) »
Le mamelon se trouve bien au-dessus de la poignée

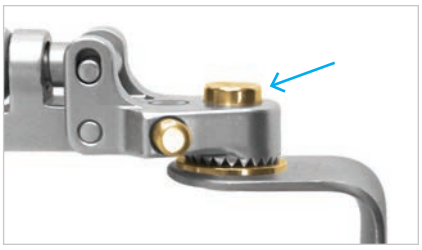

Lame « SO » (Swivel Only, pivotante uniquement)
Le mamelon se trouve au-dessus de la poignée

Poignées d'inclinaison Micro-Adjustable II :

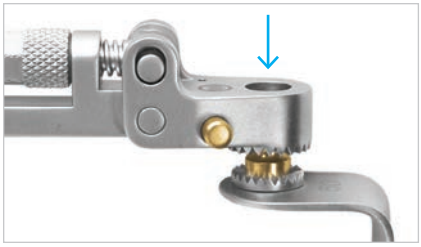

Lame « SL » en position « SWIVEL (PIVOTANTE) »
Le mamelon se trouve bien en dessous de la poignée

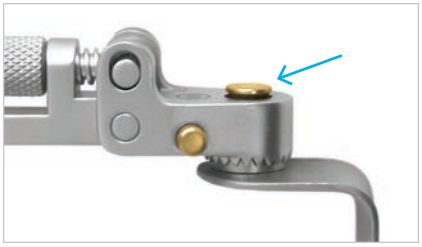

Lame « SL » en position « LOCKED (VERROUILLÉE) »
Le mamelon se trouve juste au-dessus de la poignée

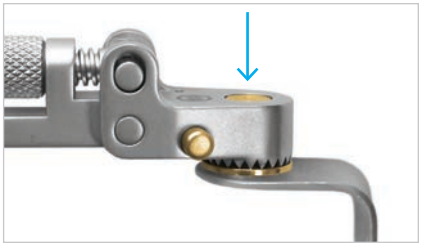

Lame « SO » (Swivel Only, pivotante uniquement)
Le mamelon se trouve juste en dessous, presque au ras de la poignée

REMARQUE :
Contrairement aux lames « SL », les lames « SO » ne contiennent pas de dentelures.

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
téléphone: +1 231 922 0177
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye
PAYS-BAS

Rév. C
060520
slockssumah-fr

CE 0297

Made In USA

© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock®, PLA® et le logo représentant un T dans un cercle sont des marques déposées de Thompson Surgical Instruments, Inc.